

MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 12:25:57

Durée: 3mn 50s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CHERIF GOPOU
Date de naissance	01/01/1990	
Age	35	
Société	EFAGAS	
ID	25011112242737297	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

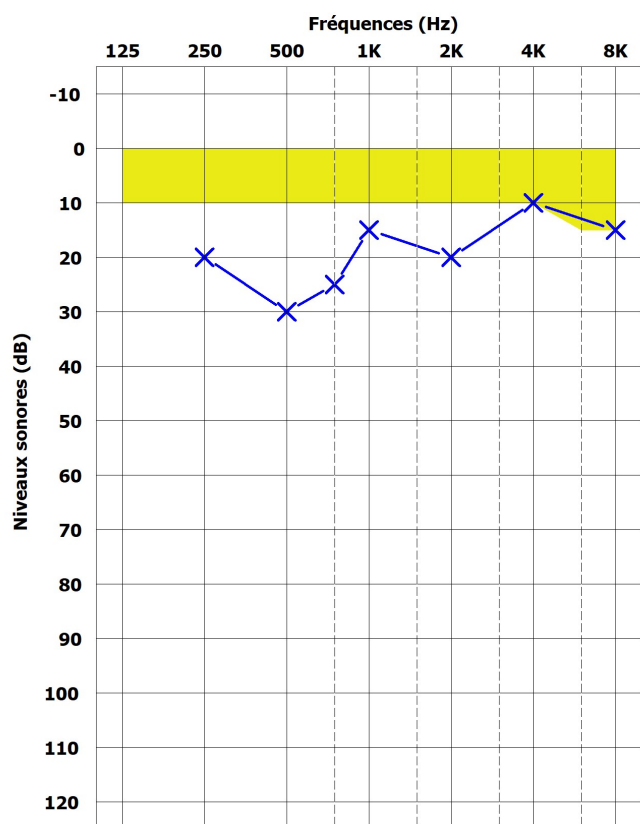

Oreille Gauche

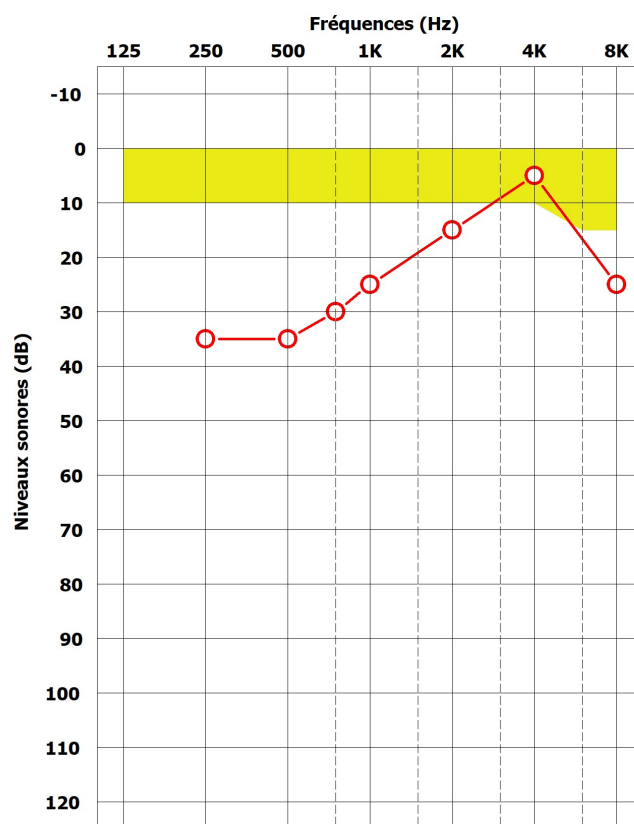

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	30	25	15		20		10		15
CA Droit		35	35	30	25		15		5		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes