

MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 15:39:12

Durée: 3mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DORE LAH
Date de naissance	01/01/1985	
Age	40	
Société	EGAS	
ID	25011115423854758	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

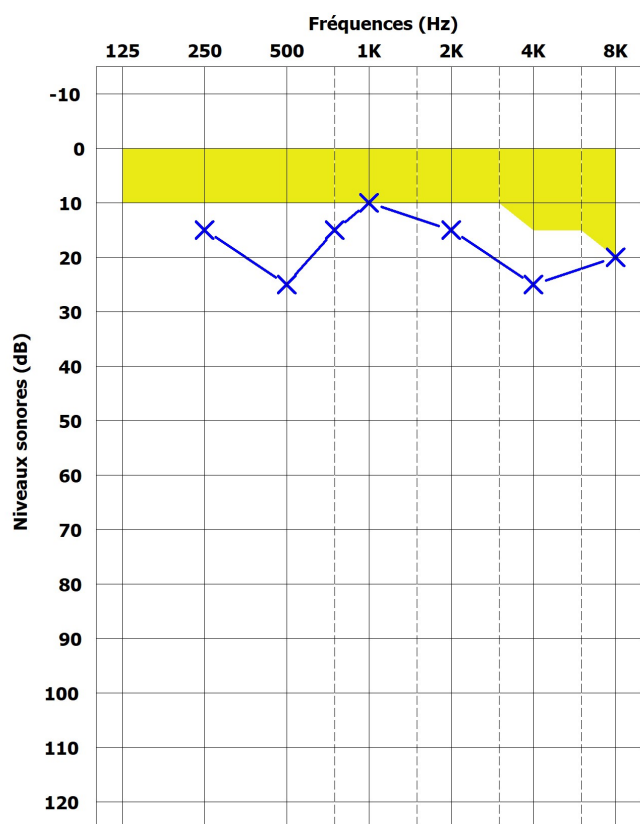

Oreille Gauche

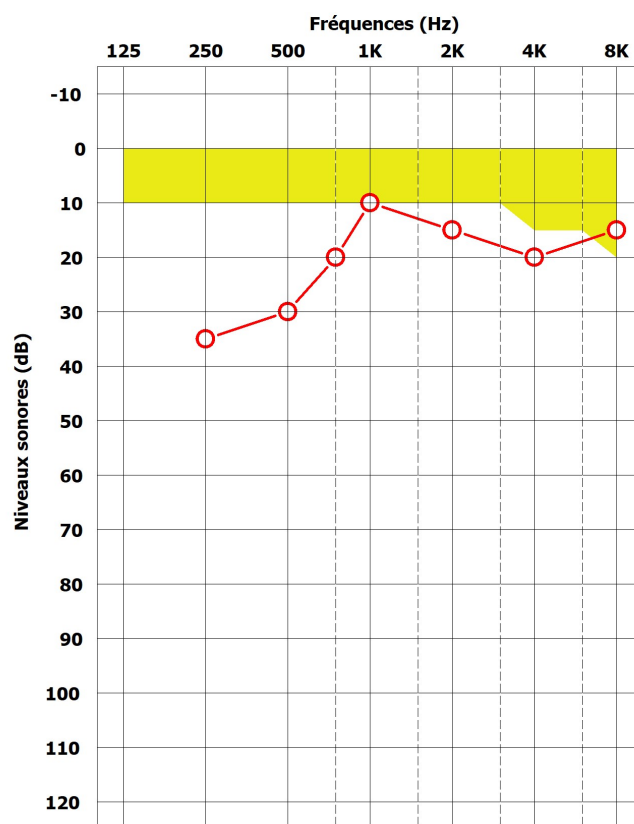

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	15	10		15		25		20
CA Droit		35	30	20	10		15		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes