

MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 15:23:56

Durée: 4mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAMBA VERONIQUE	
Date de naissance	01/01/1994
Age	31
Société	EGAS
ID	25011115163680713

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

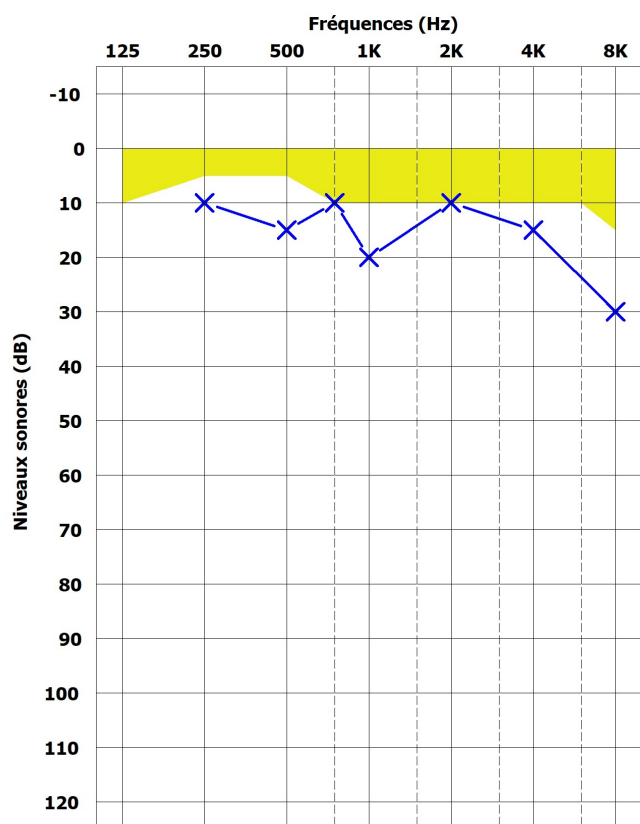

Oreille Gauche

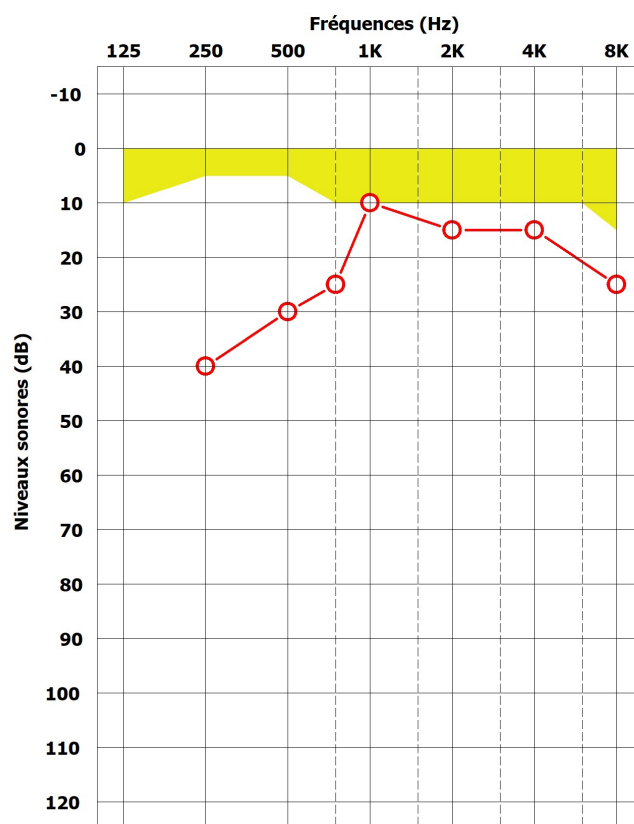

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	20		10		15		30
CA Droit		40	30	25	10		15		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes