


Données Patient	BAMBA ROMAINE
Date de naissance	02/03/1993
Age	31
Société	EGAS
ID	25011114392152594


MEDVIE

Date du test: 11/01/2025 14:41:33
 Durée: 6mn 20s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

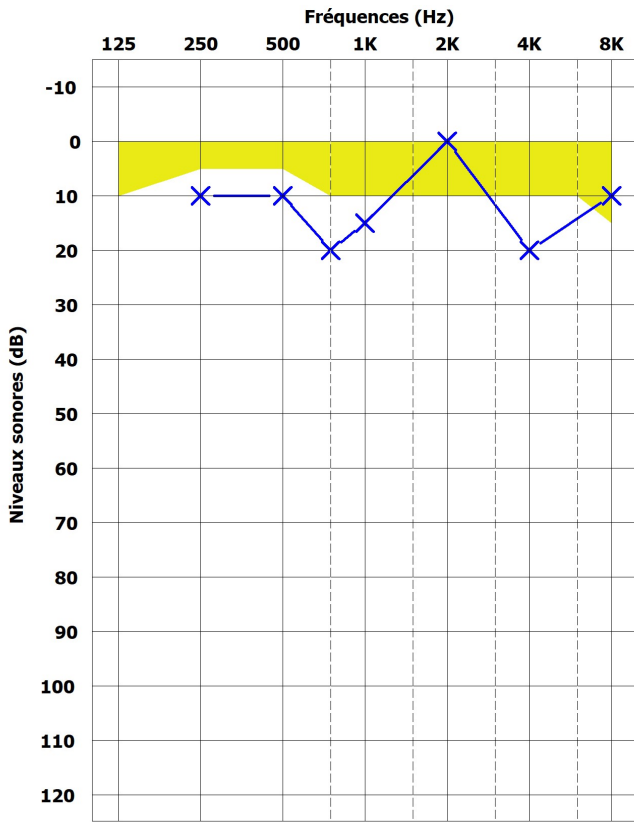

Oreille Gauche

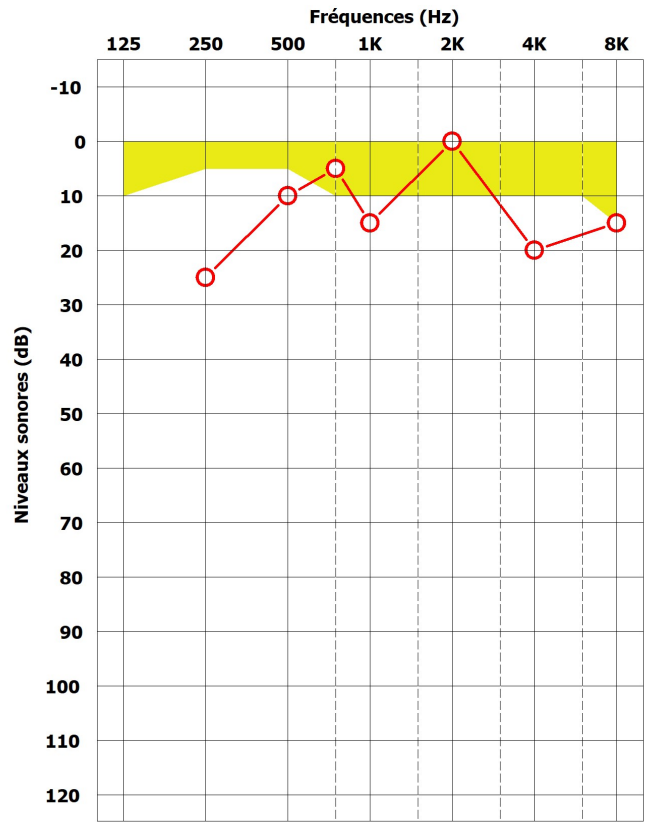

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	20	15		0		20		10
CA Droit		25	10	5	15		0		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes