


MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 13:06:14
Durée: 5mn 43s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	NINAHARA RUTH
Date de naissance	01/01/1987
Age	38
Société	EGAS
ID	25011112535561905

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

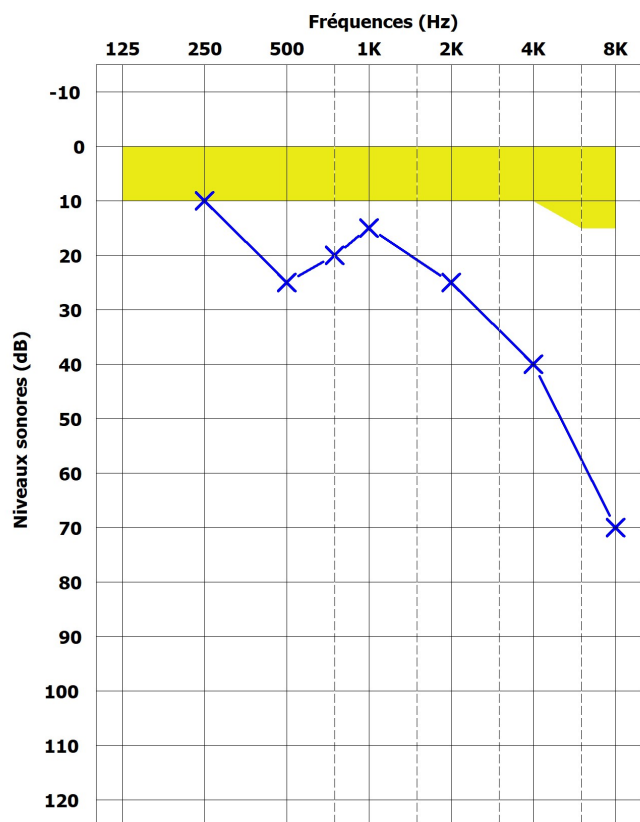

Oreille Gauche

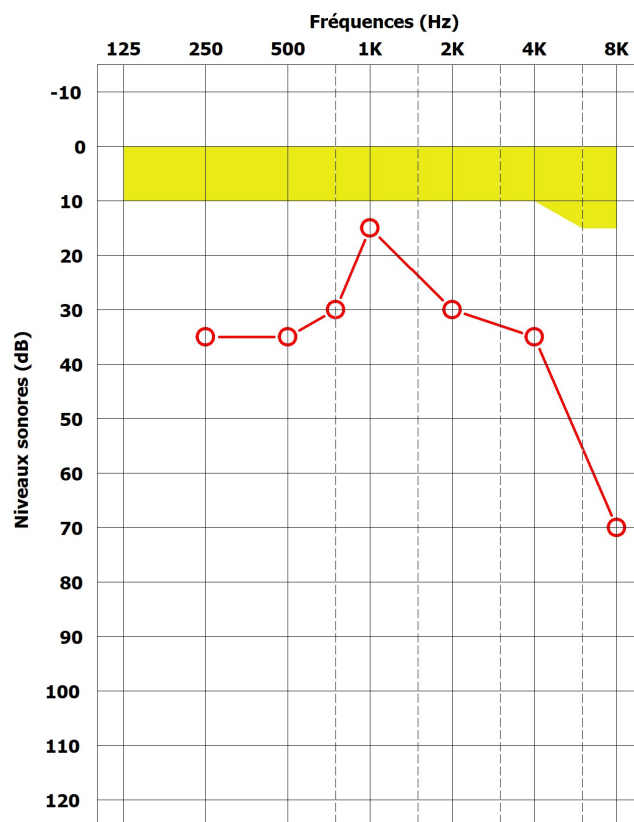

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	20	15		25		40		70
CA Droit		35	35	30	15		30		35		70

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes