

MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 14:52:00

Durée: 3mn 42s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DORE PLOAN	
Date de naissance	01/01/1992
Age	33
Société	EGAS
ID	25011114420359170

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

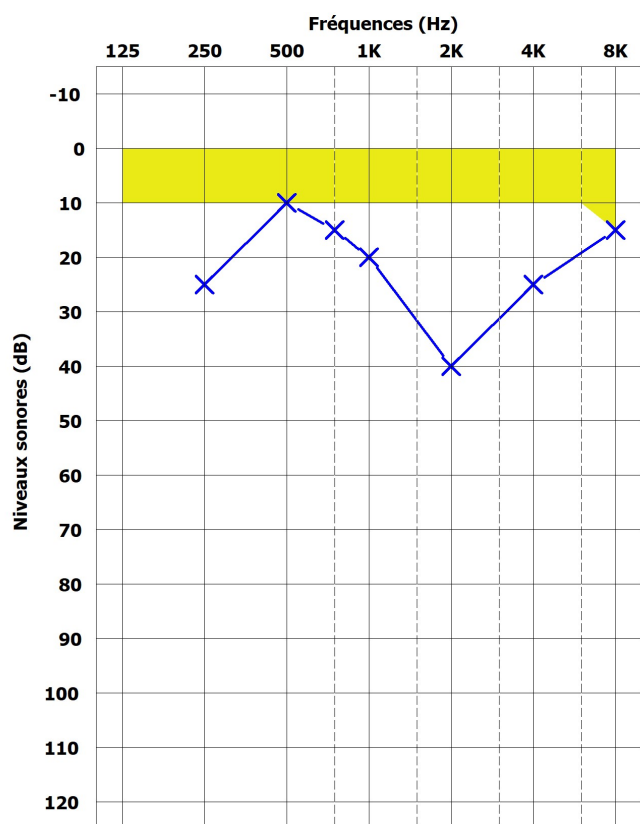

Oreille Gauche

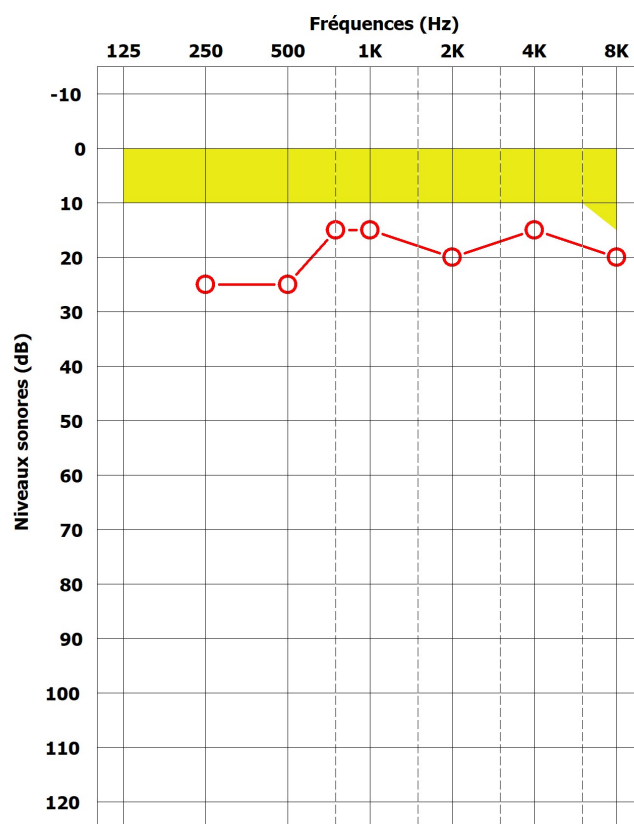

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	10	15	20		40		25		15
CA Droit		25	25	15	15		20		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes