


MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 15:15:49
Durée: 5mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DORE MAME
Date de naissance	01/01/1994	
Age	31	
Société	EGAS	
ID	25011115133908655	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

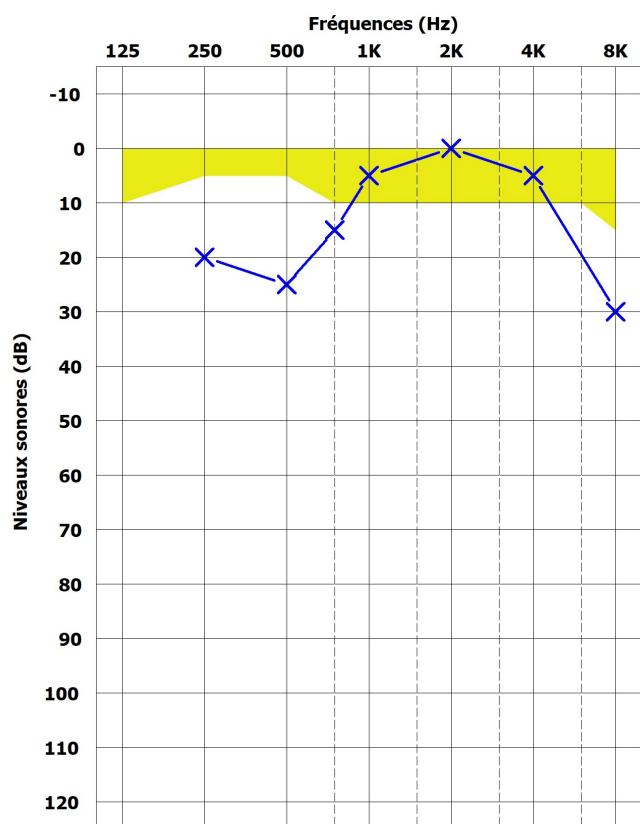

Oreille Gauche

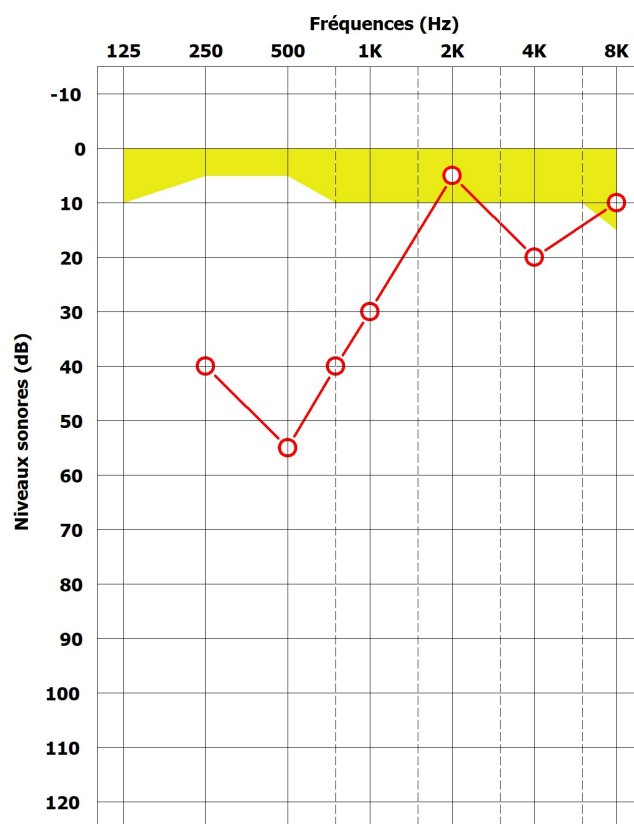

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	5		0		5		30
CA Droit		40	55	40	30		5		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes