

MEDVIE

Date du test: 11/01/2025 13:14:27

Durée: 4mn 24s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **GBANAHARA GERMAINE**

Date de naissance 01/01/1994

Age 31

Société EGAS


ID 25011113000174088

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

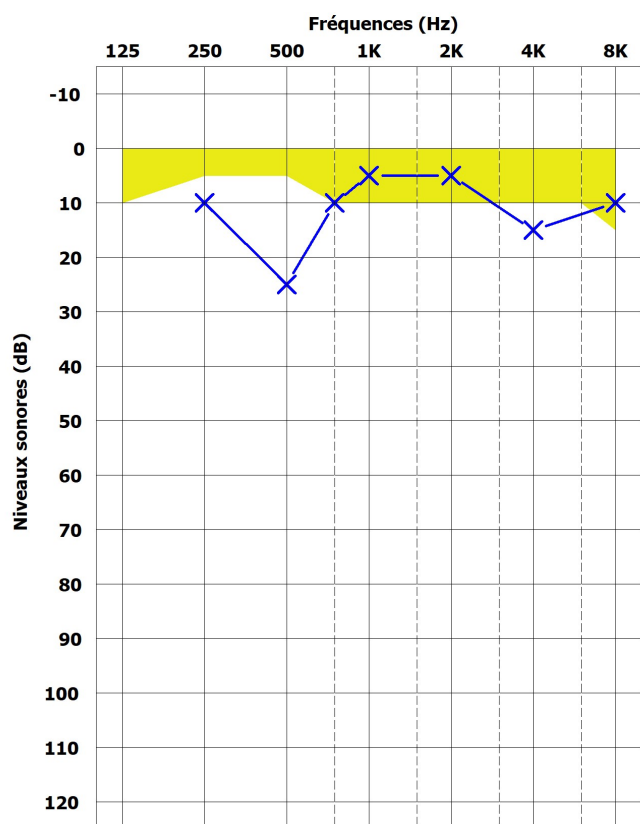

Oreille Gauche

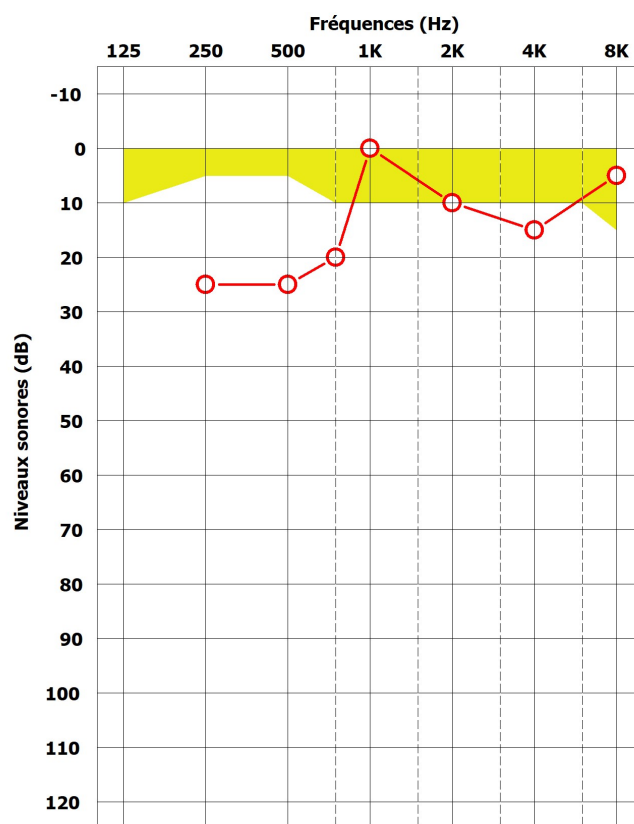

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	10	5		5		15		10
CA Droit		25	25	20	0		10		15		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes