


MEDVIE


Date du test: 11/01/2025 14:31:20
Durée: 5mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA YOWE ROGER	
Date de naissance	29/06/1986
Age	38
Société	EGAS
ID	25011114250718083

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

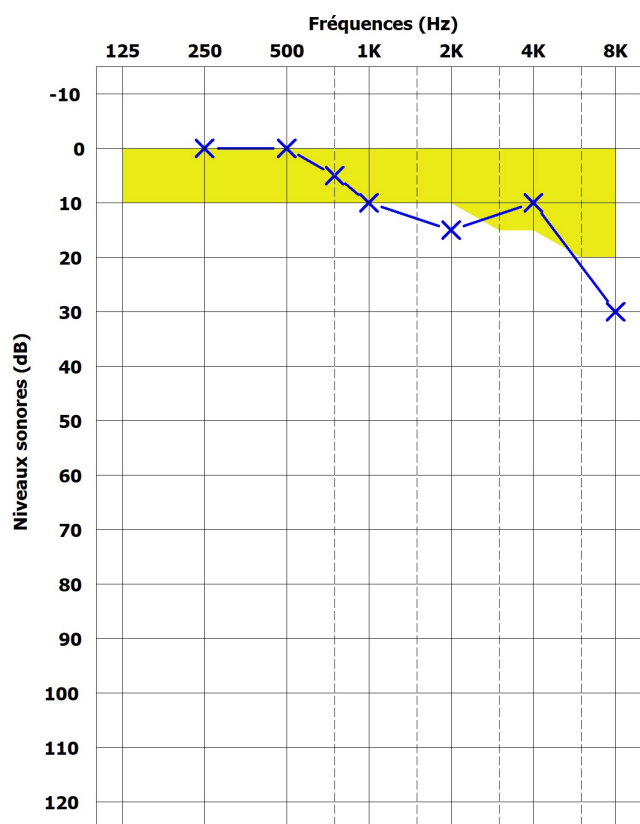

Oreille Gauche

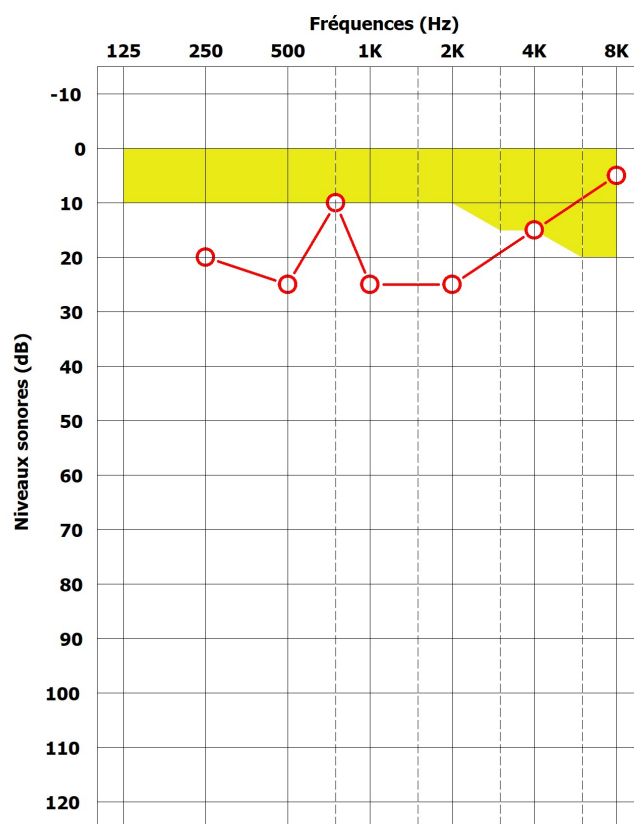

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0	5	10		15		10		30
CA Droit		20	25	10	25		25		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes