


MEDVIE


Date du test: 01/04/2025 11:04:42

Durée: 6mn 30s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

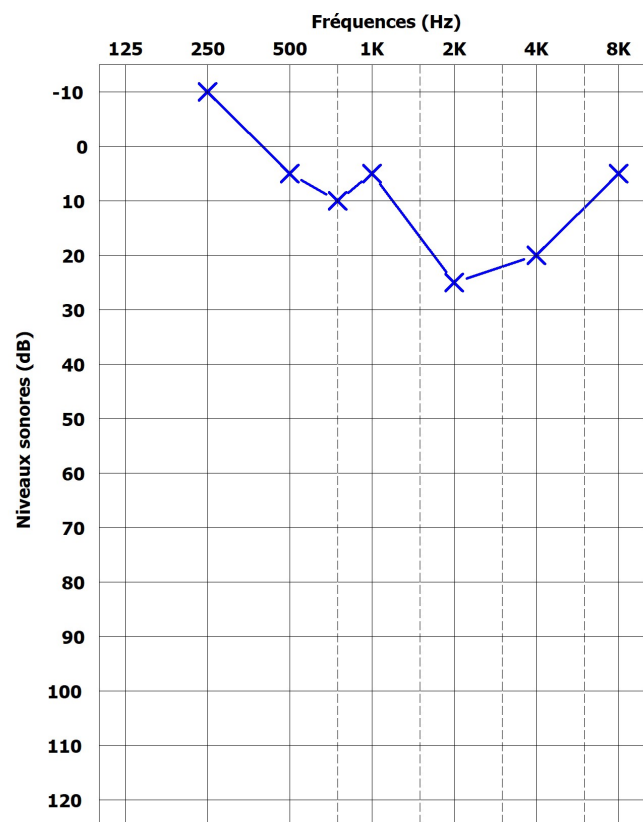

Oreille Gauche

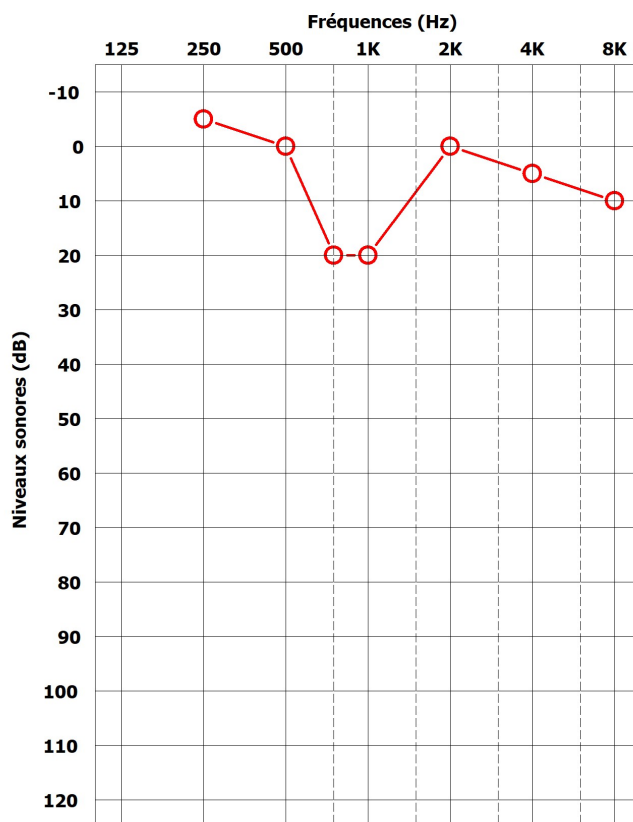

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	5	10	5		25		20		5
CA Droit		-5	0	20	20		0		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	SOUMAH GADIRY
Date de naissance	18/12/1997
Age	27
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25040111014526048

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021