


MEDVIE


Date du test: 28/05/2025 10:01:11

Durée: 5mn 51s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

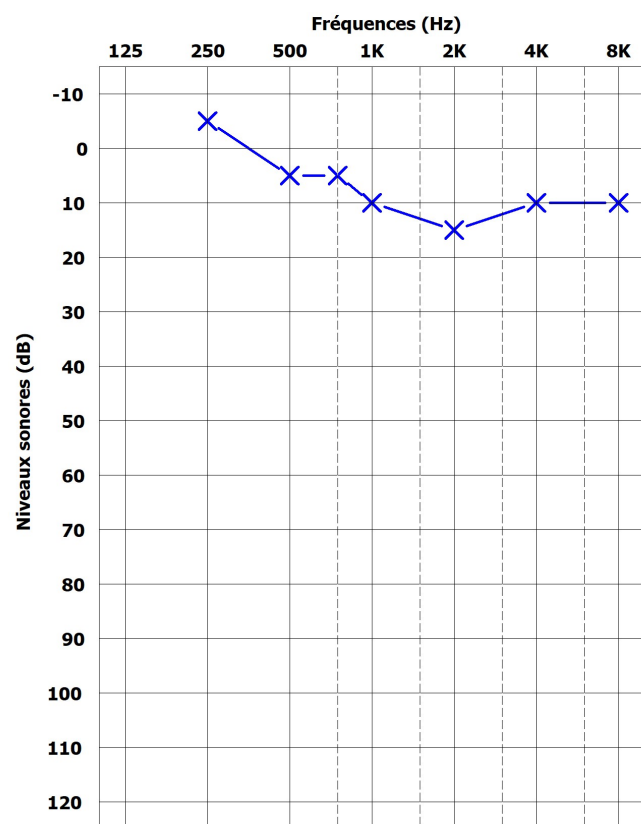

Oreille Gauche

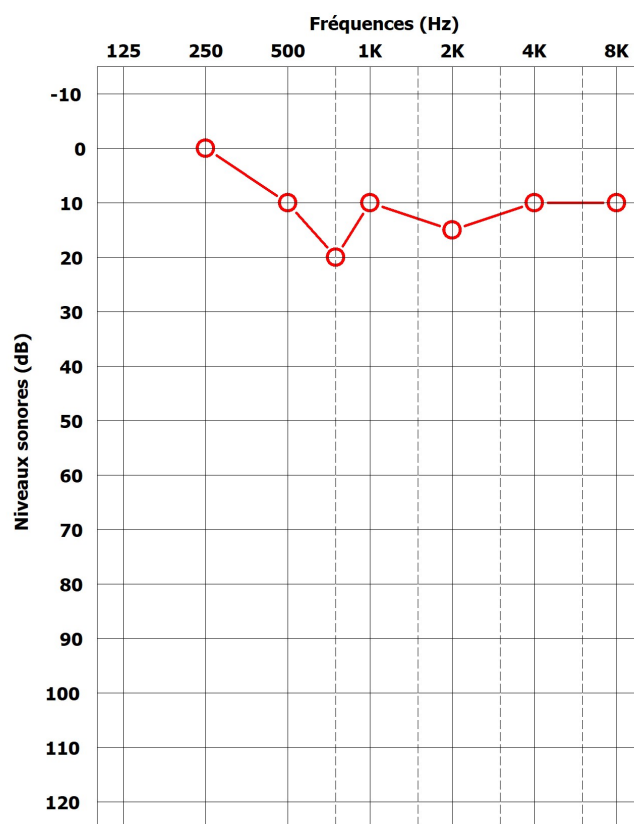

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	5	10		15		10		10
CA Droit		0	10	20	10		15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	BANGOURA Abdoulaye
Date de naissance	12/04/1988
Age	37
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25052809585027010

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021