

MEDVIE


Date du test: 29/03/2025 10:58:16

Durée: 4mn 30s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient    |                   |
|--------------------|-------------------|
| CONDE ABDOUL KARIM |                   |
| Date de naissance  | 01/01/1990        |
| Age                | 35                |
| Société            | AFRICA TRANSPORT  |
| ID                 | 25032910545280411 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

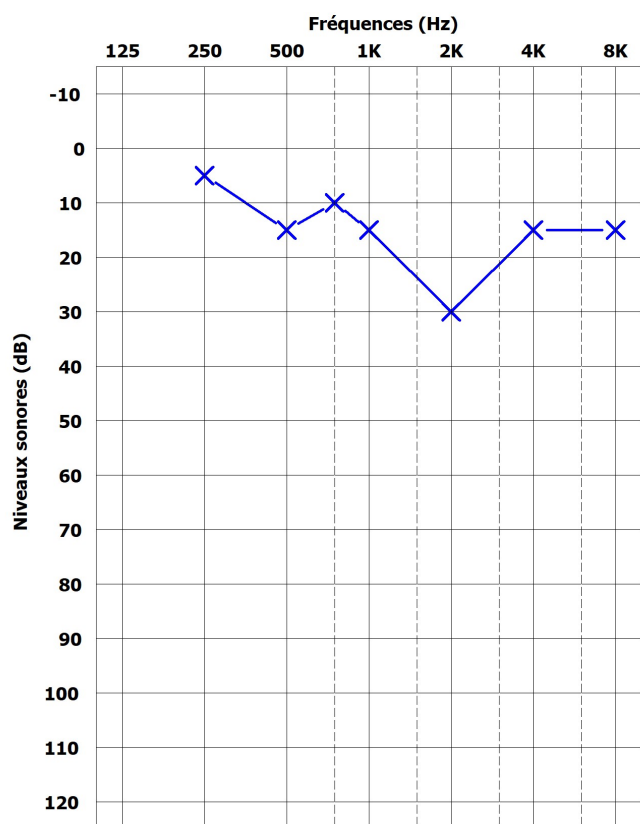

Oreille Gauche

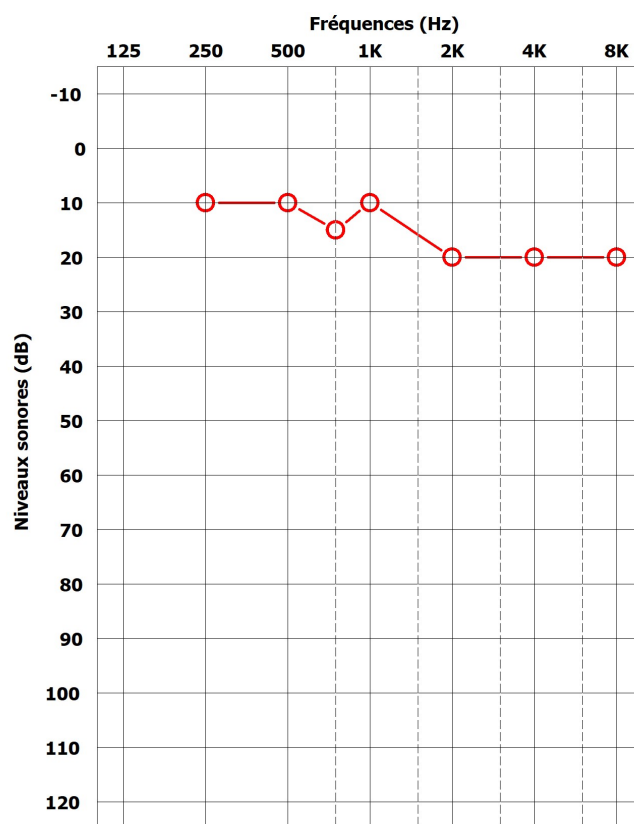

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 15  | 10  | 15 |     | 30 |    | 15 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 10  | 10  | 15  | 10 |     | 20 |    | 20 |    | 20 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 18,8 dB | --- |
| CA Droit        | 15,0 dB | --- |

Notes