

MEDVIE


Date du test: 08/04/2025 11:04:10

Durée: 5mn 08s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BANGOURA JOHN
Date de naissance	01/01/1990
Age	35
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25040810533255361

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

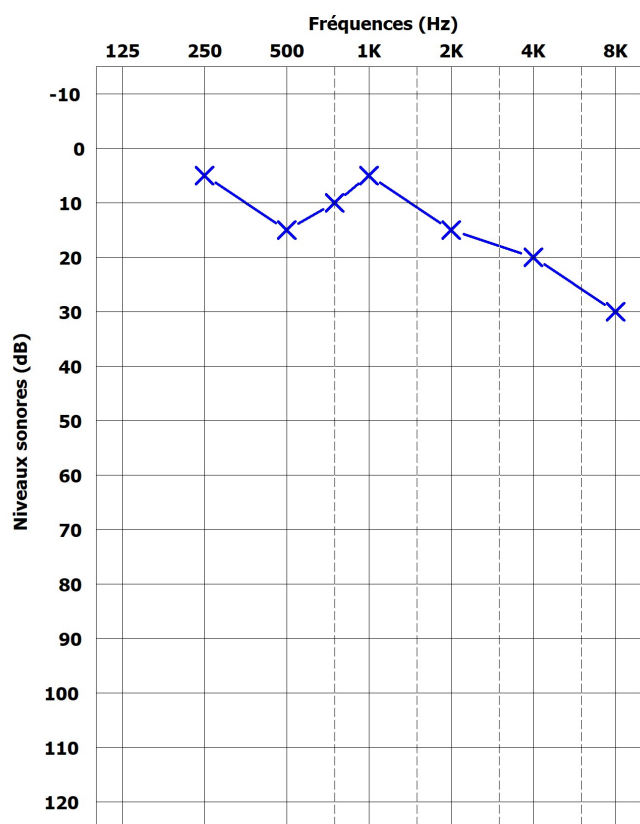

Oreille Gauche

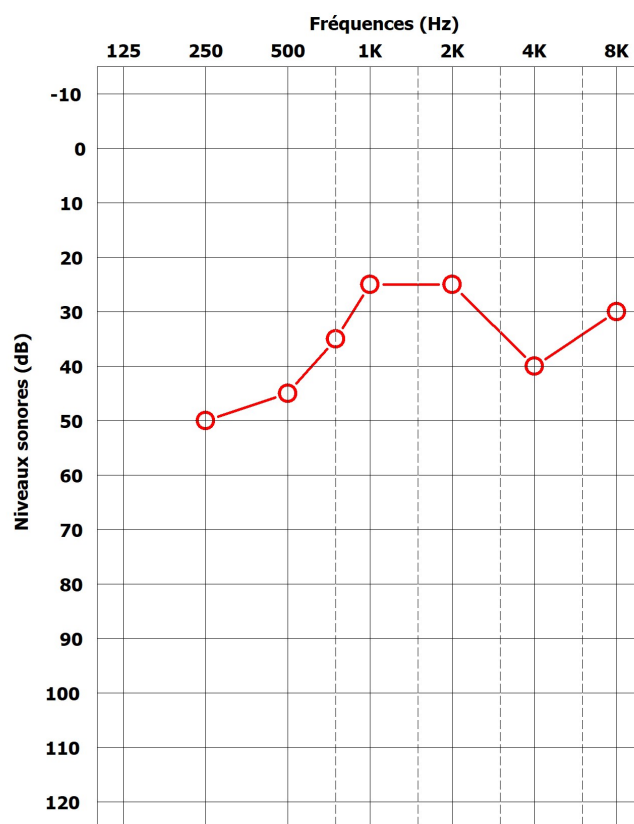

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	10	5		15		20		30
CA Droit		50	45	35	25		25		40		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	33,8 dB	---

Notes