


MEDVIE


Date du test: 29/04/2025 13:13:17

Durée: 7mn 19s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

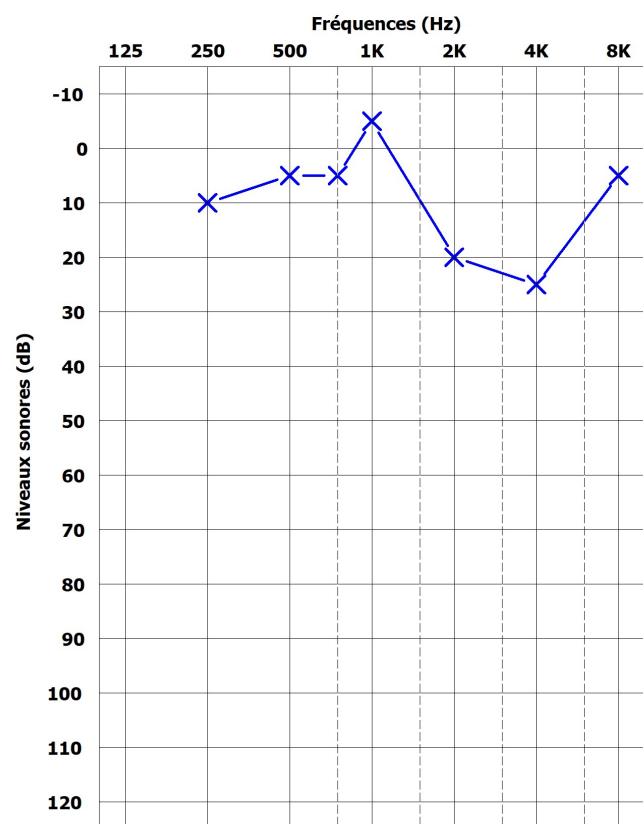

Oreille Gauche

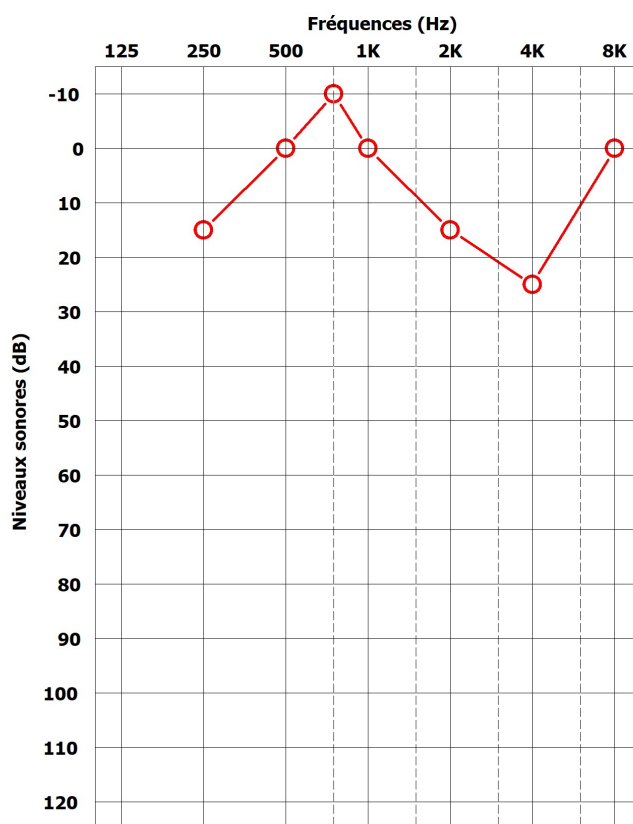

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5	5	-5		20		25		5
CA Droit		15	0	-10	0		15		25		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	SOUMAH SEKOU
Date de naissance	07/01/1984
Age	41
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25042913104503096

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021