


MEDVIE


Date du test: 21/03/2025 13:17:58

Durée: 11mn 18s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

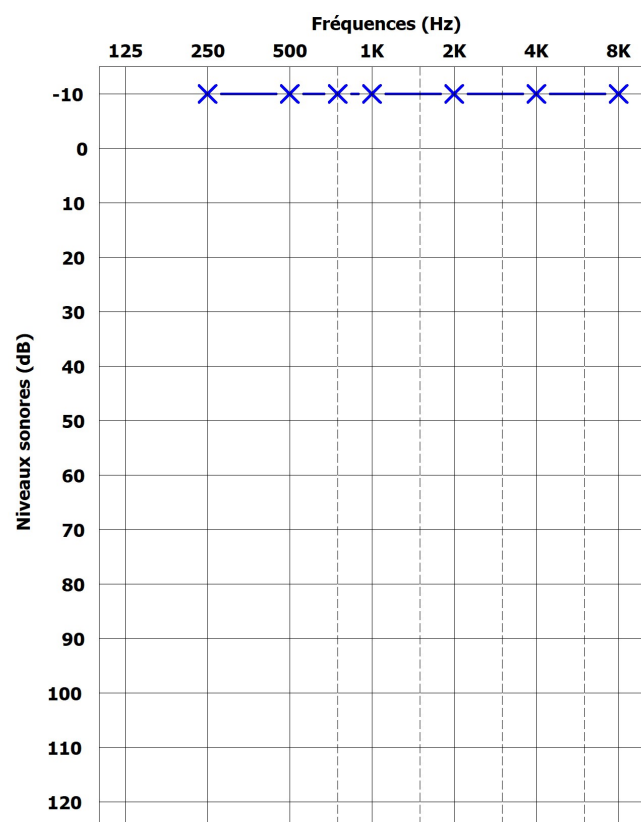

Oreille Gauche

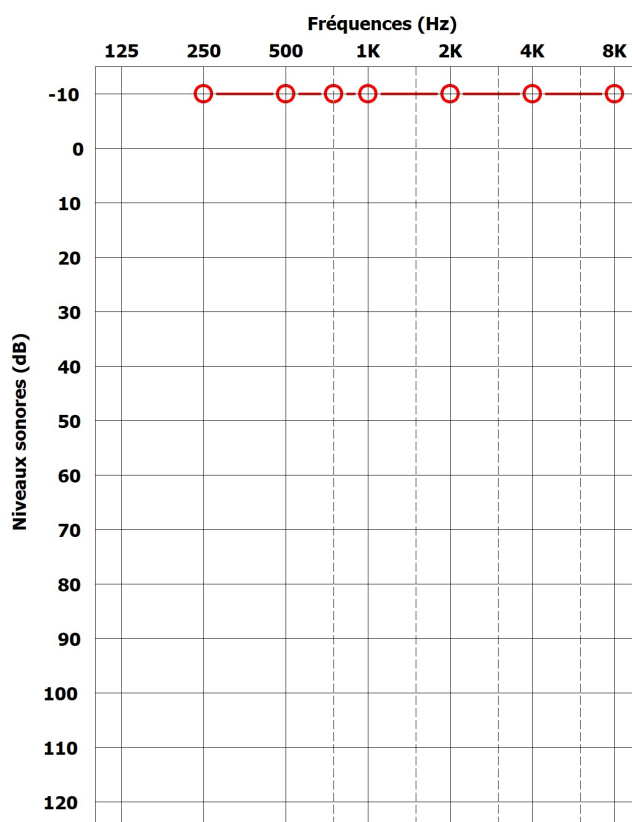

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	-10	-10		-10		-10		-10
CA Droit		-10	-10	-10	-10		-10		-10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-10,0 dB	---
CA Droit	-10,0 dB	---

Notes

Données Patient

DOUMBOUYA BOUBACAR

Date de naissance

01/01/1992

Age

33

Société

AFRICA TRANSPORT

ID

25032113155157308

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021