


MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 09:39:59  
Durée: 7mn 14s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | BAH MAMADOU SAIDOU |
|-------------------|--------------------|
| Date de naissance | 01/01/1990         |
| Age               | 35                 |
| Société           | AFRICA TRANSPORT   |
| ID                | 25031809355672859  |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

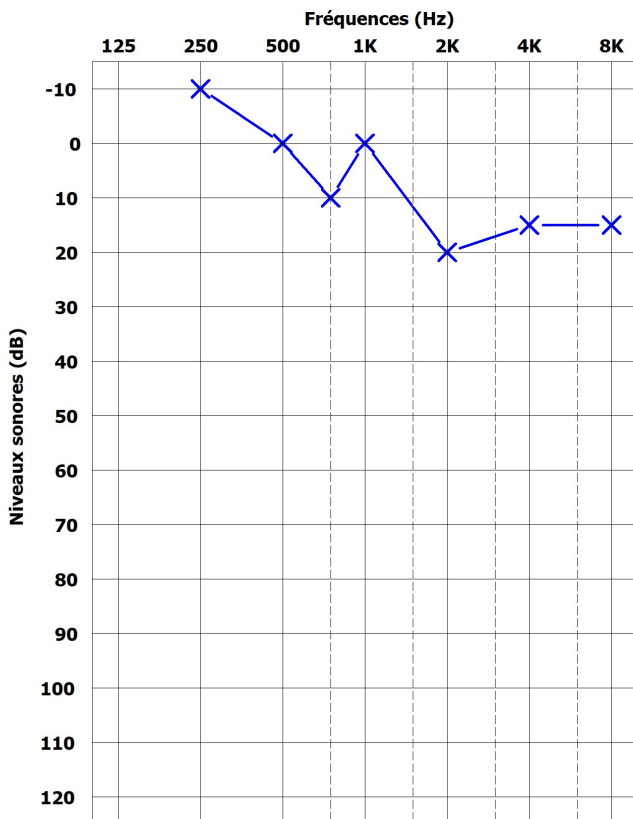

Oreille Gauche

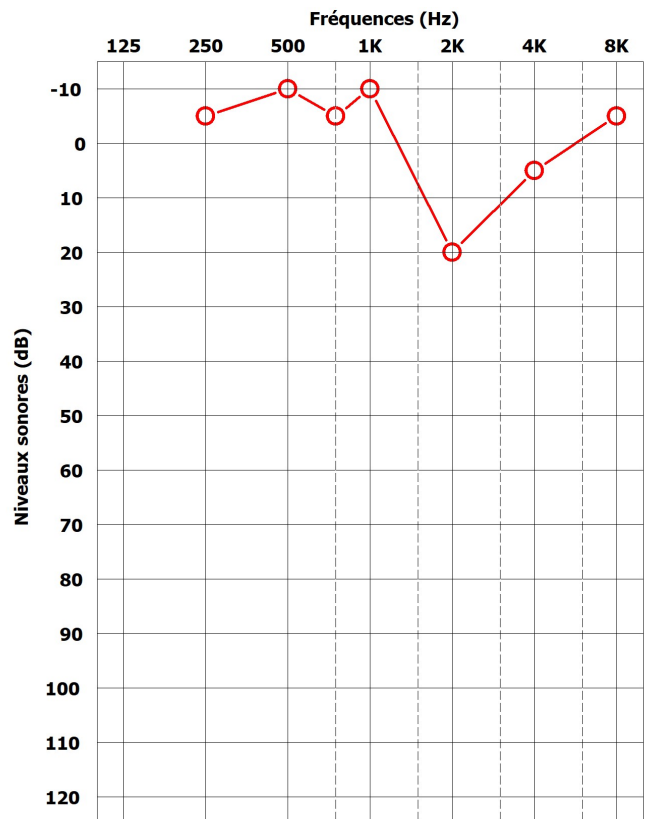

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k  | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | -10 | 0   | 10  | 0   |     | 20 |    | 15 |    | 15 |
| CA Droit  |     | -5  | -10 | -5  | -10 |     | 20 |    | 5  |    | -5 |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 8,8 dB | --- |
| CA Droit        | 1,3 dB | --- |

Notes