


MEDVIE


Date du test: 19/03/2025 11:20:02
Durée: 10mn 01s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIALLO MAMADOU SAI IONI
Date de naissance	14/11/1985
Age	39
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25031911084989300

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

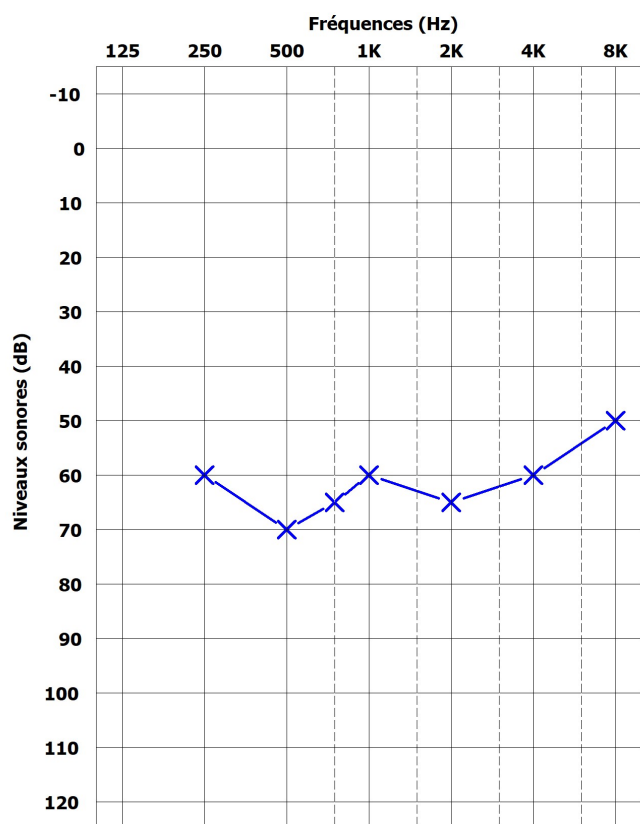

Oreille Gauche

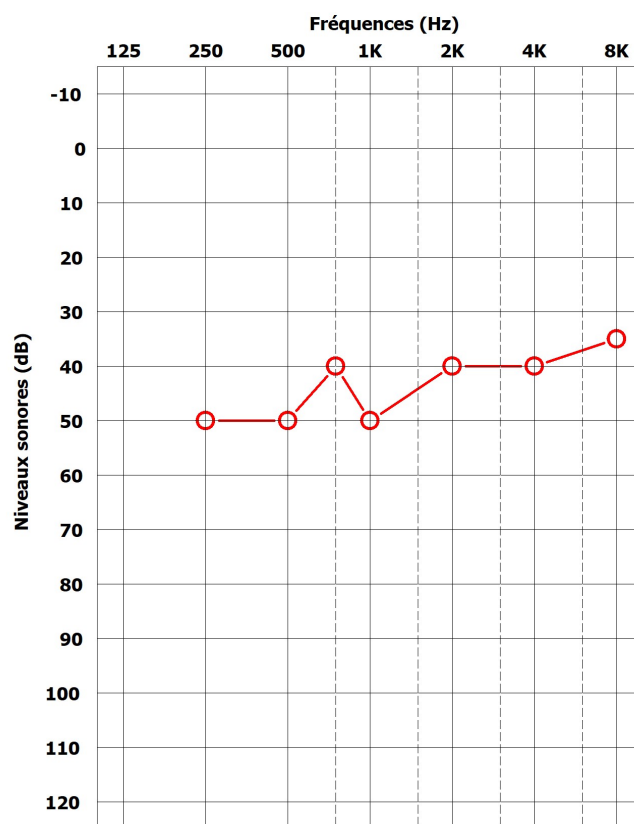

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		60	70	65	60		65		60		50
CA Droit		50	50	40	50		40		40		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	63,8 dB	---
CA Droit	45,0 dB	---

Notes