

MEDVIE


Date du test: 25/03/2025 11:28:46

Durée: 3mn 05s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA M'BEMBA	
Date de naissance	01/01/1992
Age	33
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25032511263352205

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

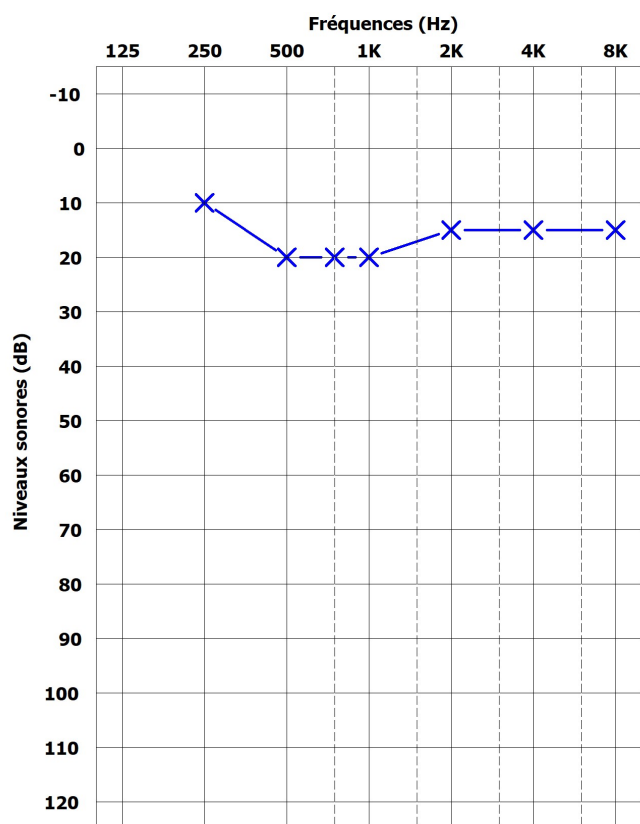

Oreille Gauche

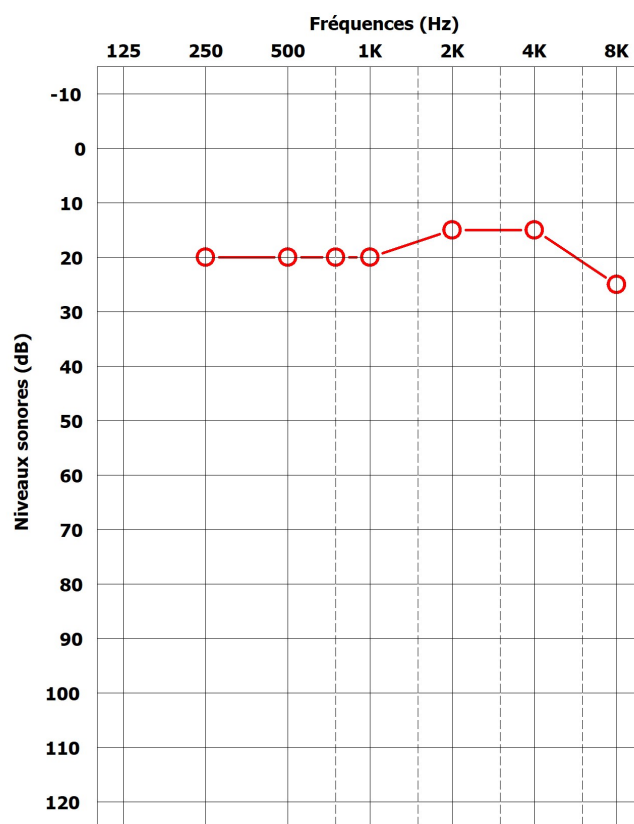

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20	20	20		15		15		15
CA Droit		20	20	20	20		15		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes