


MEDVIE


Date du test: 01/04/2025 10:30:33

Durée: 7mn 22s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

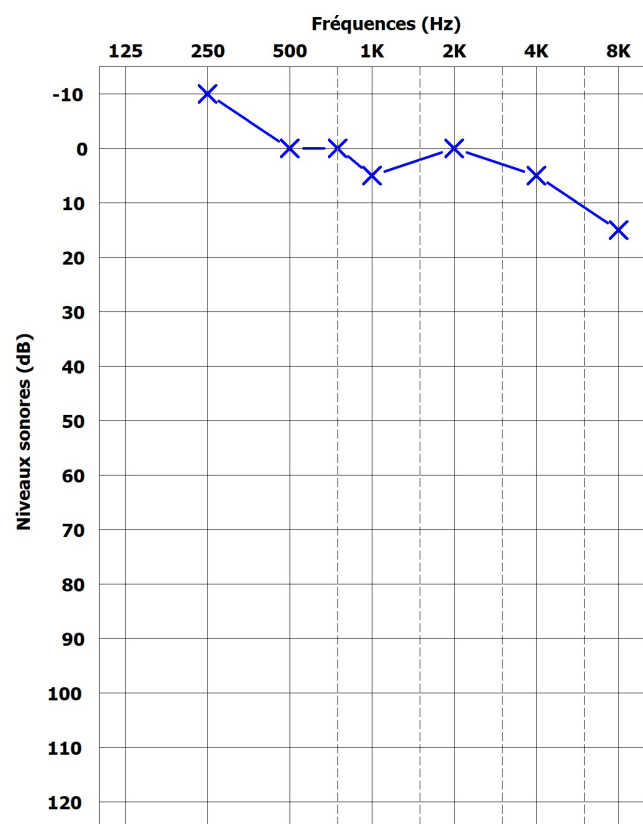

Oreille Gauche

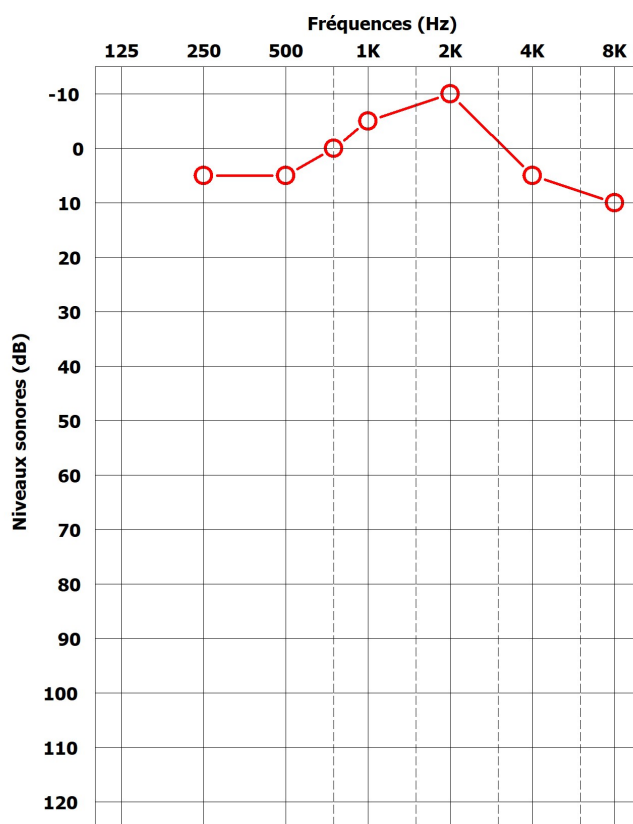

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	0	0	5		0		5		15
CA Droit		5	5	0	-5		-10		5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes

Données Patient	BIAYE NABILAYE
Date de naissance	01/01/1997
Age	28
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25040110264138600

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021