


MEDVIE


Date du test: 29/04/2025 12:17:08
Durée: 4mn 21s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAH SEYDOUBA	
Date de naissance	01/01/1996
Age	29
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25042911582843107

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

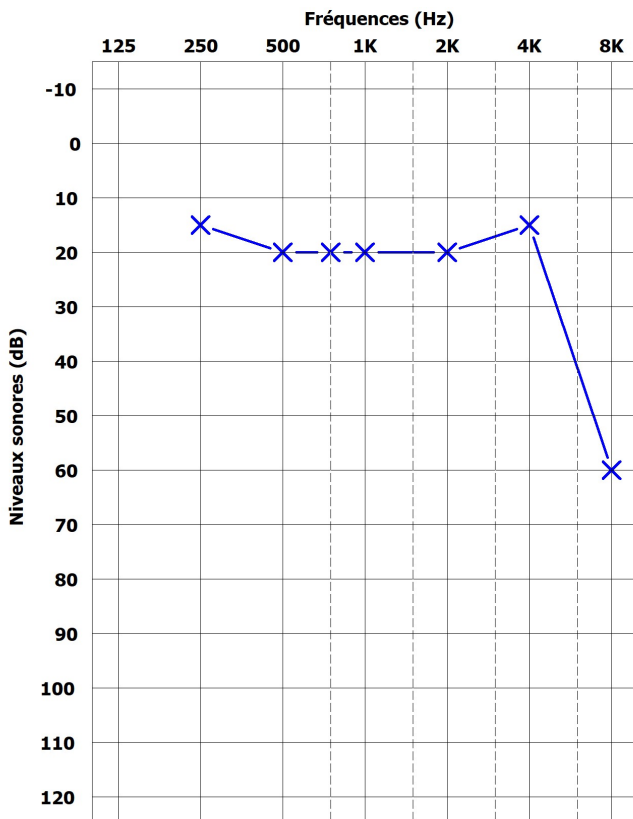

Oreille Gauche

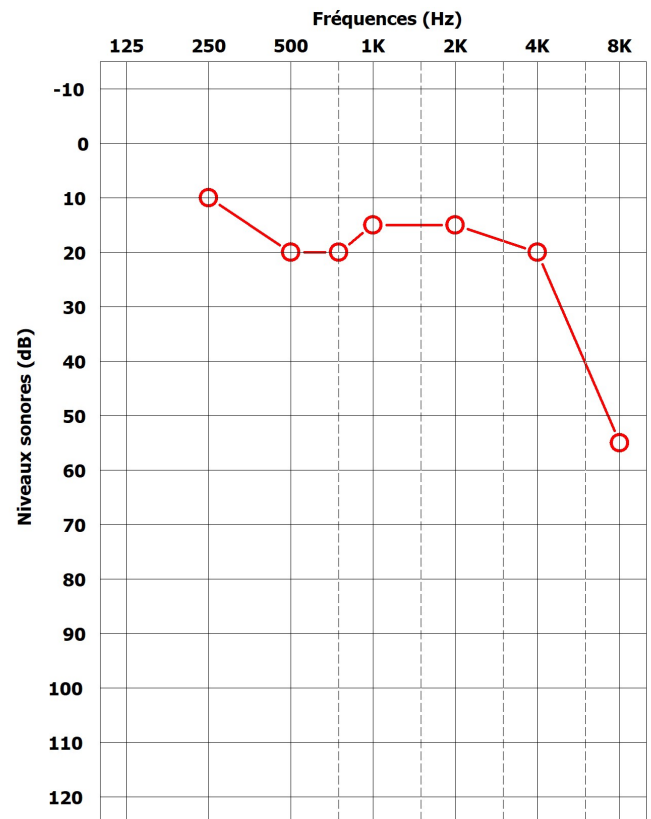

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	20	20		20		15		60
CA Droit		10	20	20	15		15		20		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes