


MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 12:21:14

Durée: 5mn 28s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

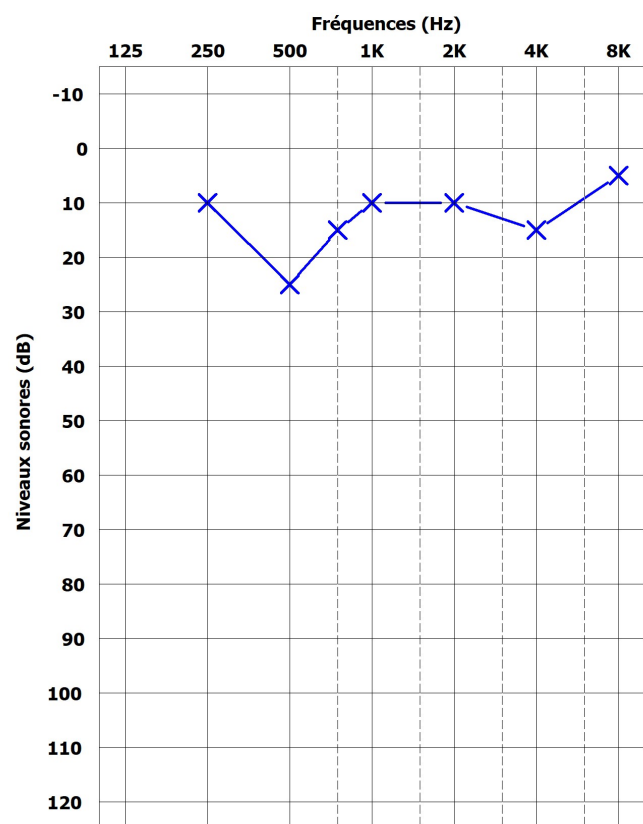

Oreille Gauche

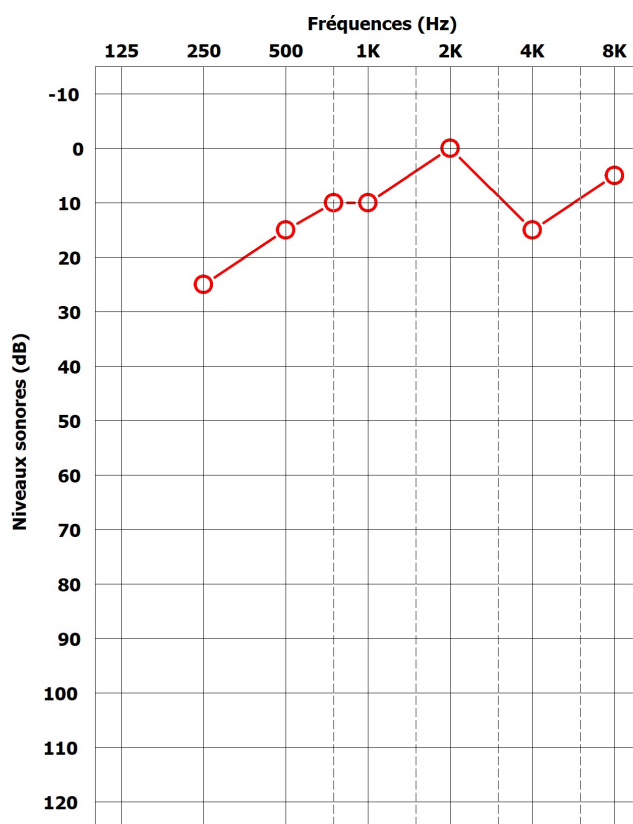

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	15	10		10		15		5
CA Droit		25	15	10	10		0		15		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	SOUMAH YAYA
Date de naissance	05/05/1990
Age	34
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25031812153690670

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021