

MEDVIE


Date du test: 29/03/2025 12:03:05

Durée: 4mn 21s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUMBOUYA MAMADOU	
Date de naissance	15/01/1984
Age	41
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25032912005210888

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

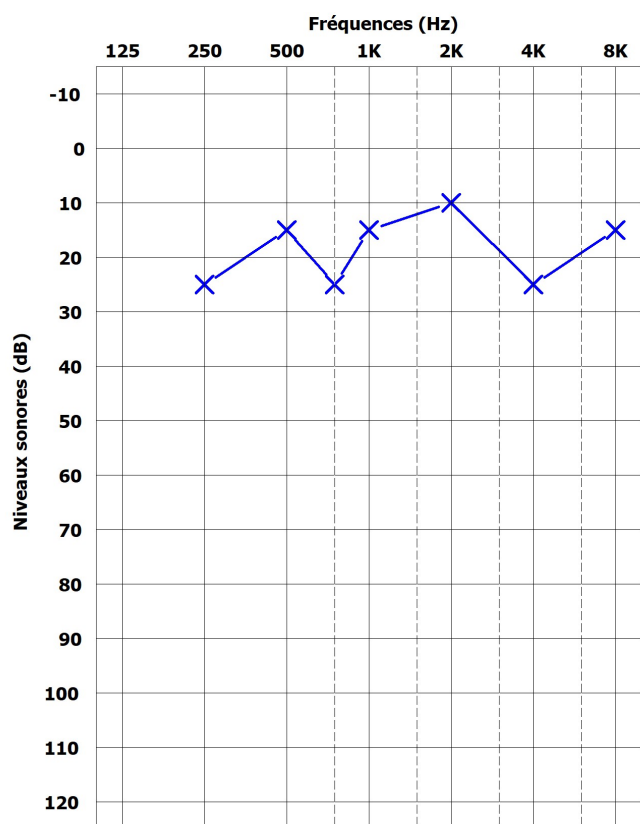

Oreille Gauche

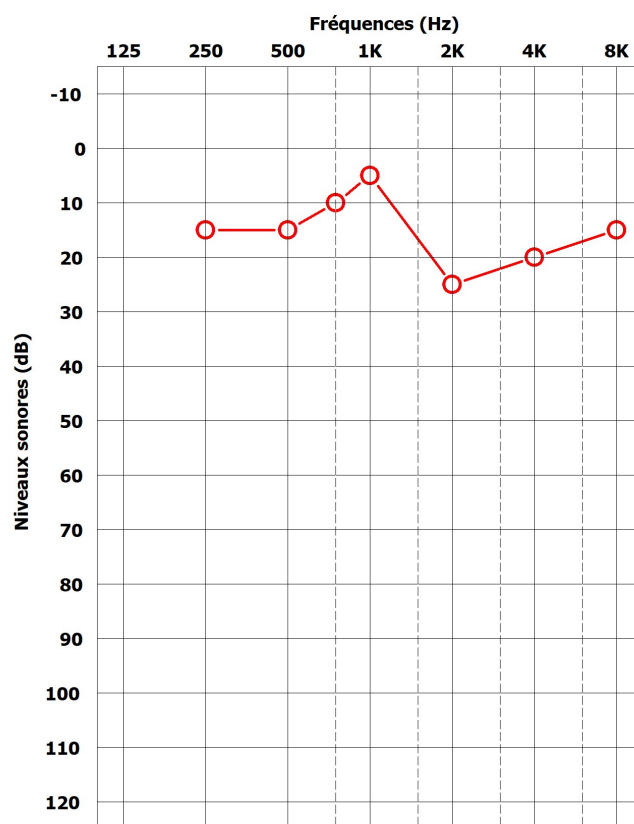

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	25	15		10		25		15
CA Droit		15	15	10	5		25		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes