


MEDVIE


Date du test: 29/03/2025 13:31:44
Durée: 7mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA SEKOU	
Date de naissance	02/12/1988
Age	36
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25032913295570375

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

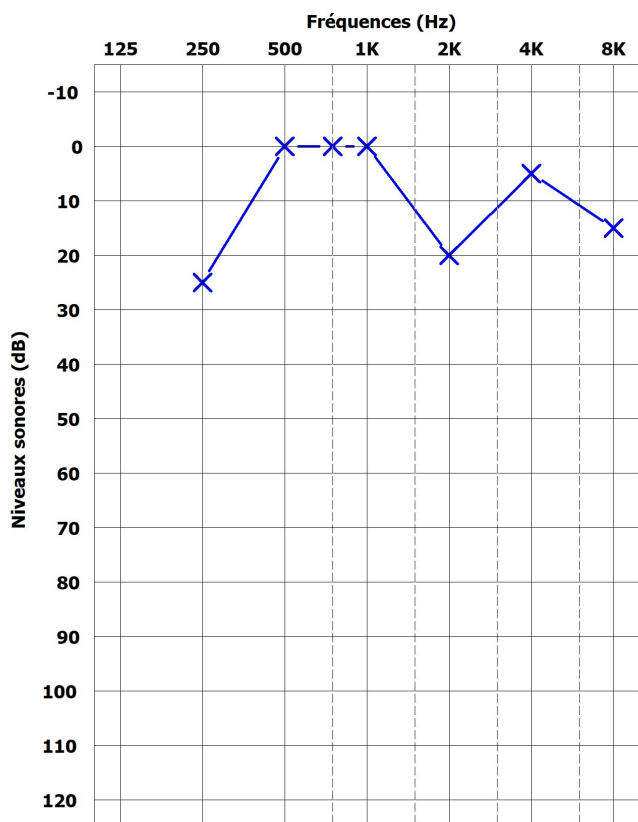

Oreille Gauche

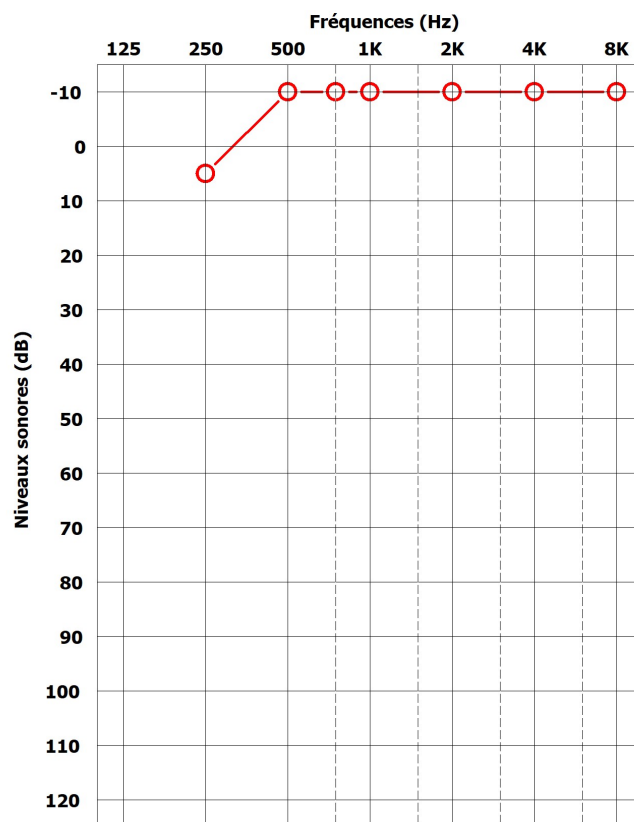

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	0	0	0		20		5		15
CA Droit		5	-10	-10	-10		-10		-10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	-10,0 dB	---

Notes