

MEDVIE


Date du test: 08/04/2025 12:12:08

Durée: 4mn 35s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SOUARE KARAMOKO
Date de naissance	08/02/1979	
Age	46	
Société	AFRICA TRANSPORT	
ID	25040812073787850	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

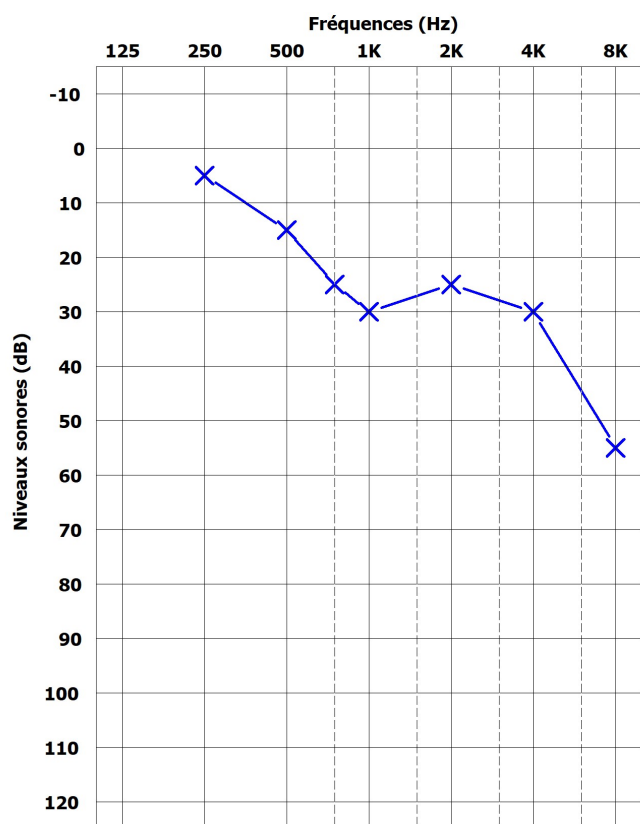

Oreille Gauche

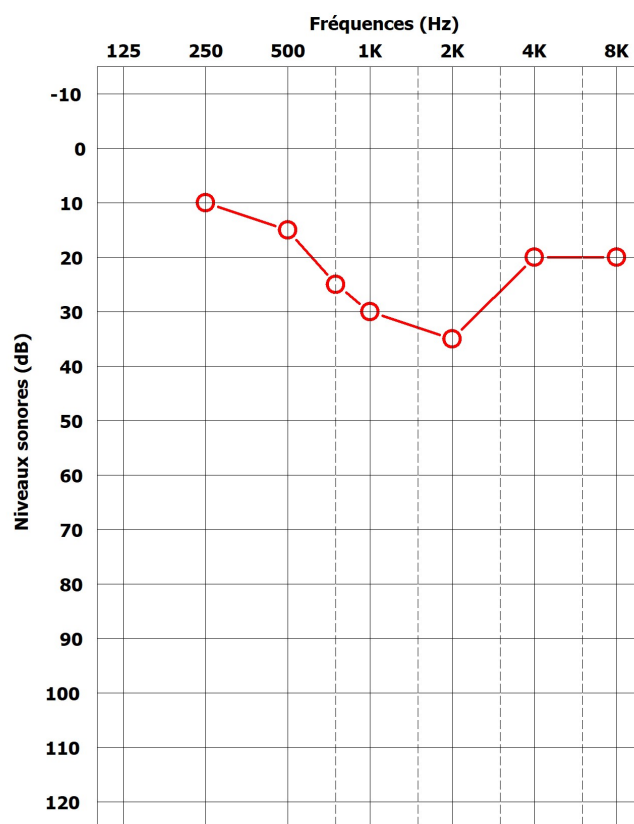

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	25	30		25		30		55
CA Droit		10	15	25	30		35		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes