

MEDVIE


Date du test: 25/03/2025 11:15:12

Durée: 4mn 34s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUMBOUYA SAYON	
Date de naissance	01/01/1995
Age	30
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25032511131517995

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

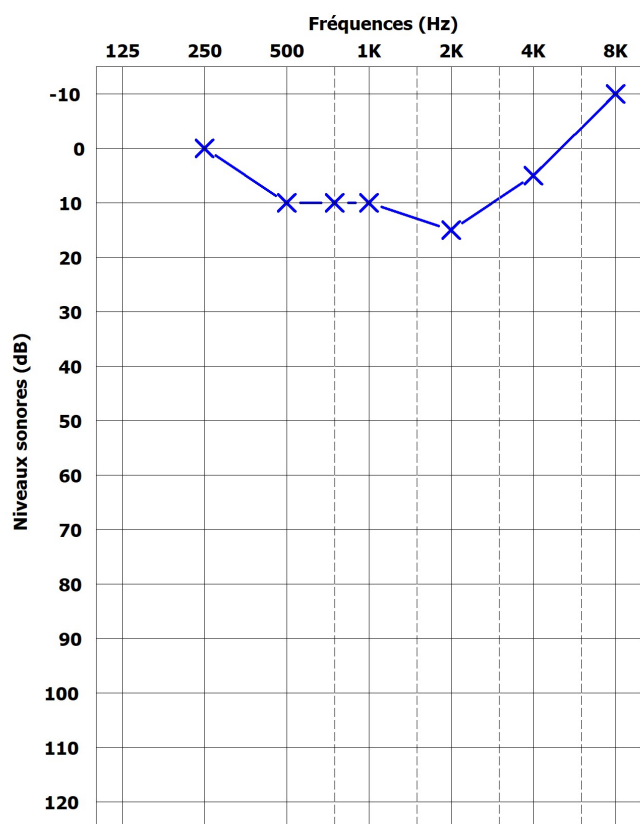

Oreille Gauche

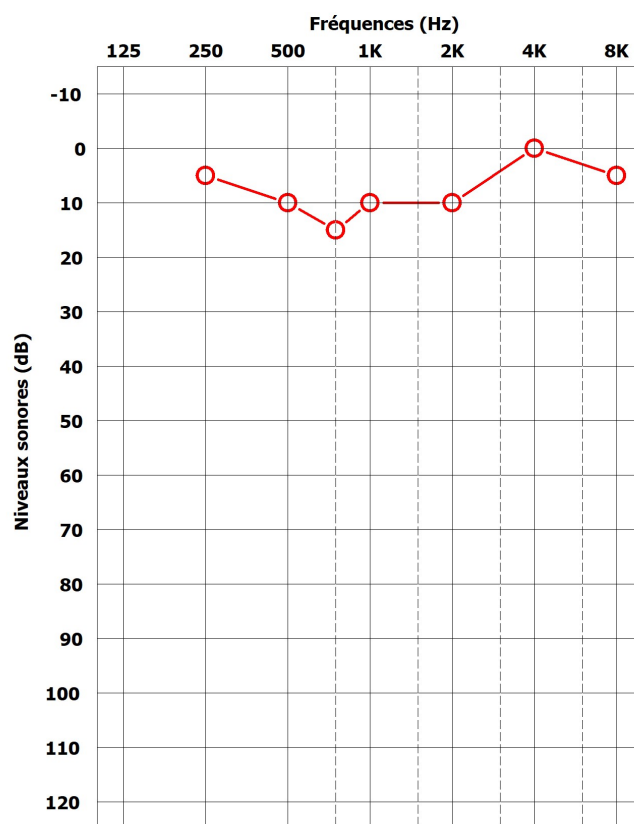

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	10	10		15		5		-10
CA Droit		5	10	15	10		10		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes