

MEDVIE


Date du test: 20/03/2025 11:24:32

Durée: 3mn 45s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | CAMARA SALIFOU    |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 24/04/1994        |
| Age               | 30                |
| Société           | AFRICA TRANSPORT  |
| ID                | 25031912023453993 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

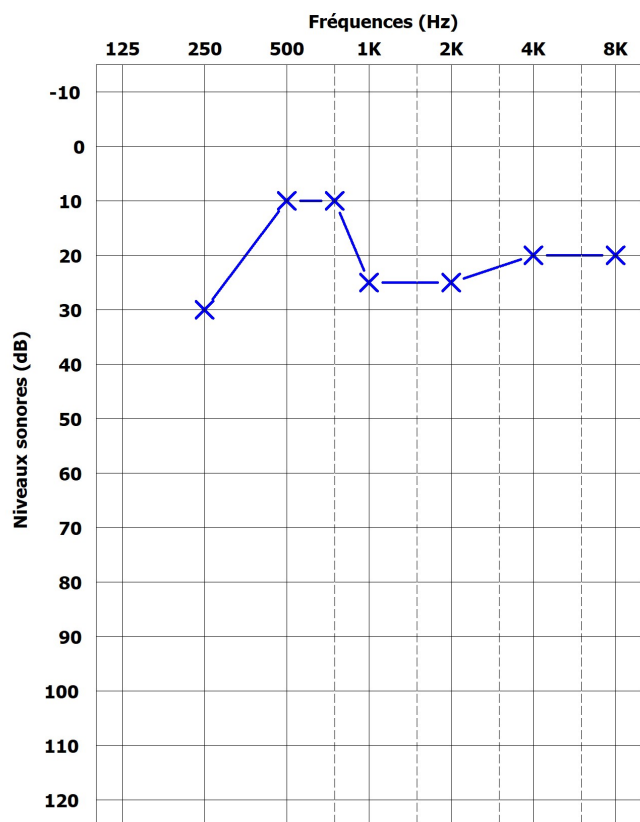

Oreille Gauche

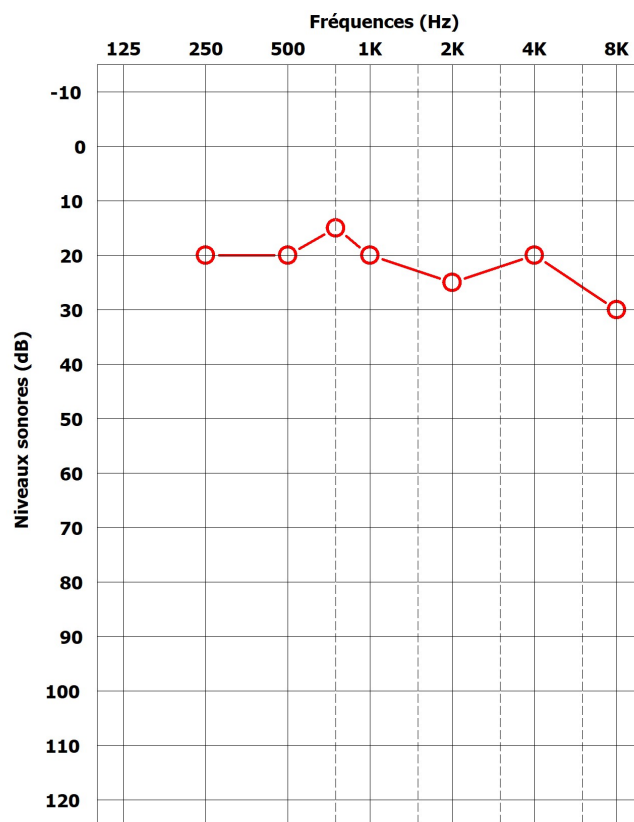

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 30  | 10  | 10  | 25 |     | 25 |    | 20 |    | 20 |
| CA Droit  |     | 20  | 20  | 15  | 20 |     | 25 |    | 20 |    | 30 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 20,0 dB | --- |
| CA Droit        | 21,3 dB | --- |

Notes