



| Données Patient        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>DIALLO BOUBACAR</b> |                   |
| Date de naissance      | 23/03/1974        |
| Age                    | 51                |
| Société                | AFRICA TRANSPORT  |
| ID                     | 25053110183341091 |

Date du test: 31/05/2025 10:28:36  
 Durée: 8mn 05s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

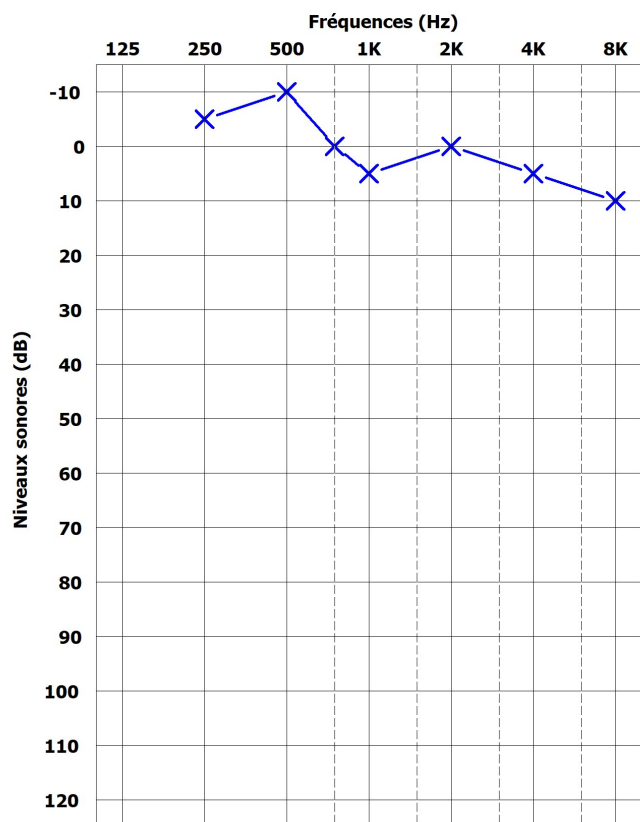

Oreille Gauche

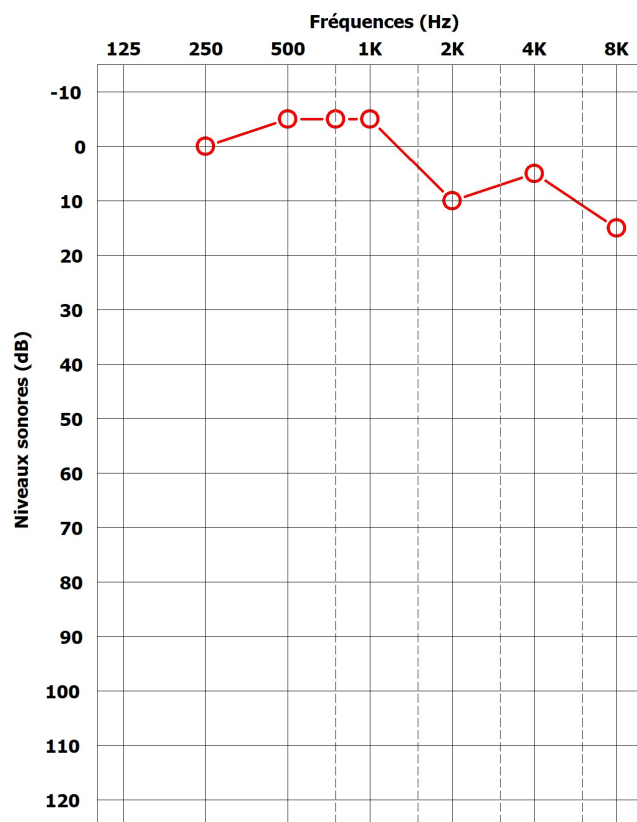

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | -5  | -10 | 0   | 5  |     | 0  |    | 5  |    | 10 |
| CA Droit  |     | 0   | -5  | -5  | -5 |     | 10 |    | 5  |    | 15 |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 0,0 dB | --- |
| CA Droit        | 1,3 dB | --- |

Notes