


MEDVIE


Date du test: 18/04/2025 09:10:59
Durée: 4mn 13s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUMBASSA MALAN	
Date de naissance	01/07/1982
Age	42
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25041809094524558

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

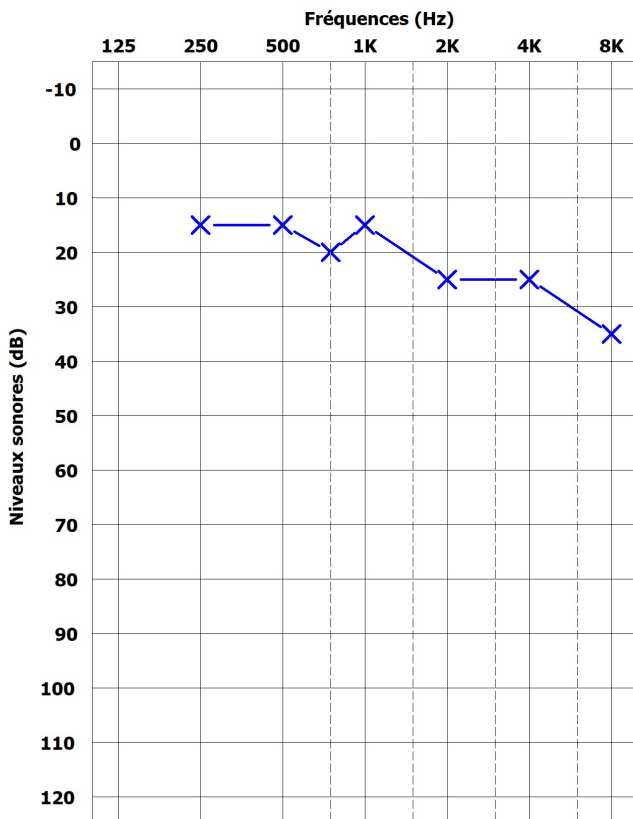

Oreille Gauche

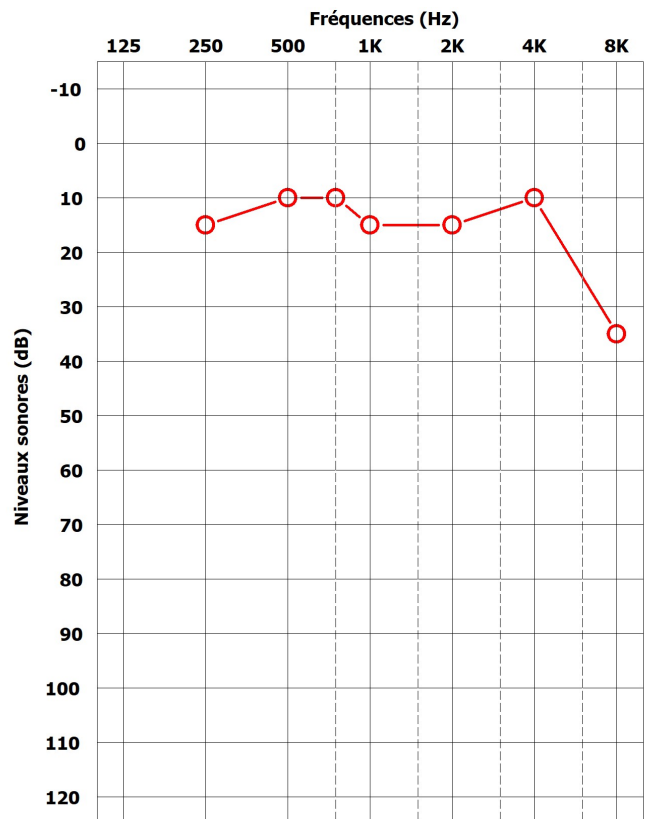

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	20	15		25		25		35
CA Droit		15	10	10	15		15		10		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes