


MEDVIE


Date du test: 29/03/2025 13:09:34
Durée: 7mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA AMADOU	
Date de naissance	01/07/1983
Age	41
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25032913055189818

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

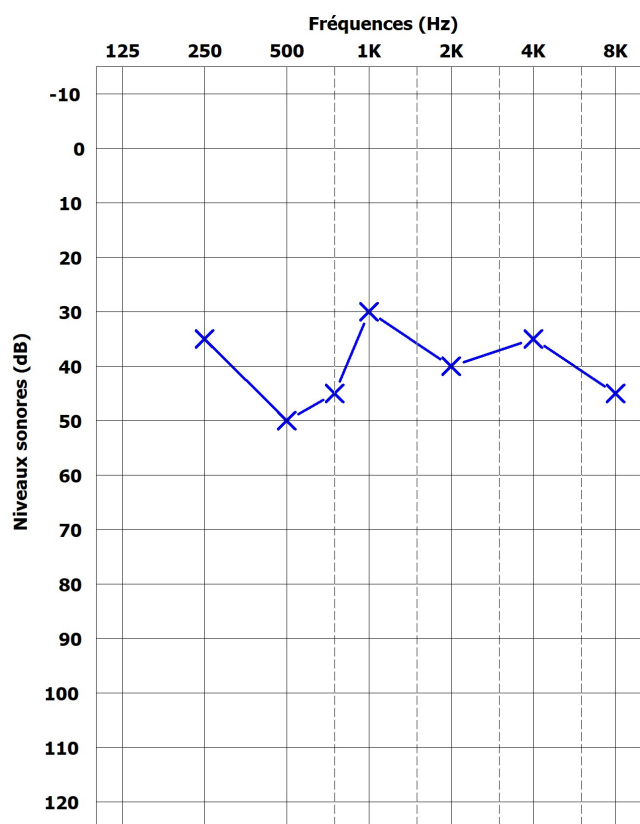

Oreille Gauche

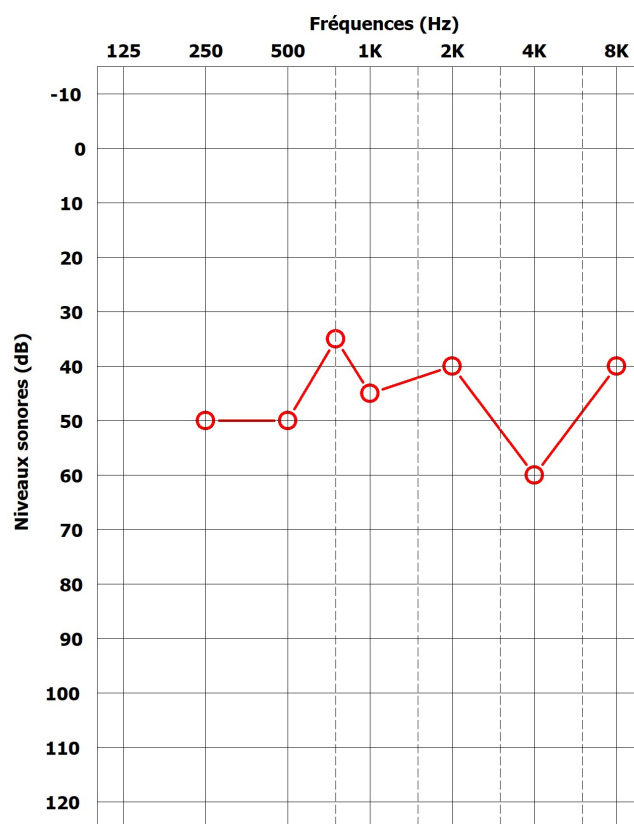

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	50	45	30		40		35		45
CA Droit		50	50	35	45		40		60		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	38,8 dB	---
CA Droit	48,8 dB	---

Notes