


MEDVIE


Date du test: 19/03/2025 11:33:58

Durée: 5mn 59s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

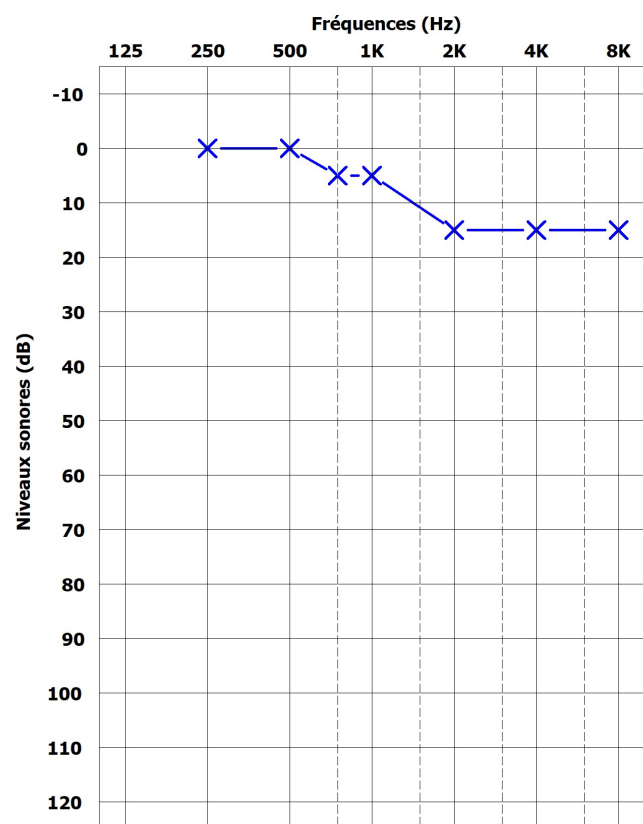

Oreille Gauche

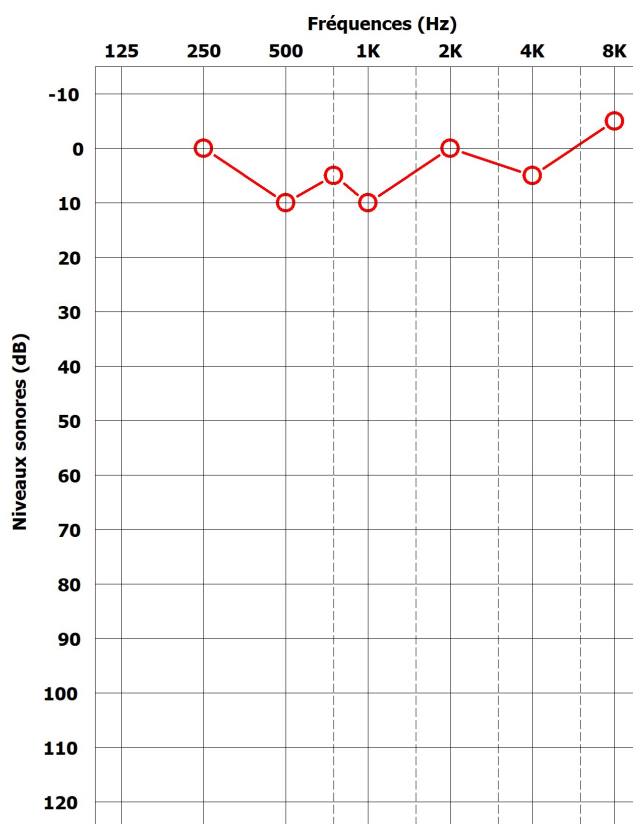

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0	5	5		15		15		15
CA Droit		0	10	5	10		0		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO MAMADOU DIAN
Date de naissance	24/02/1997
Age	28
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25031911310203364

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021