

MEDVIE

Date du test: 01/04/2025 11:26:45
Durée: 3mn 47s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

CAMARA AIYA


Date de naissance: 01/01/1993
Age: 32
Société: AFRICA TRANSPORT
ID: 25040111234692646

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

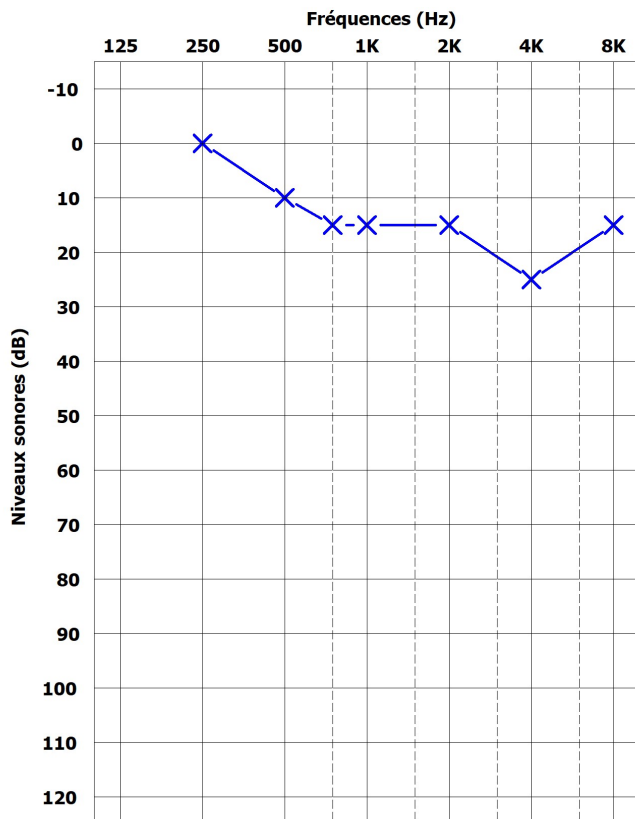

Oreille Gauche

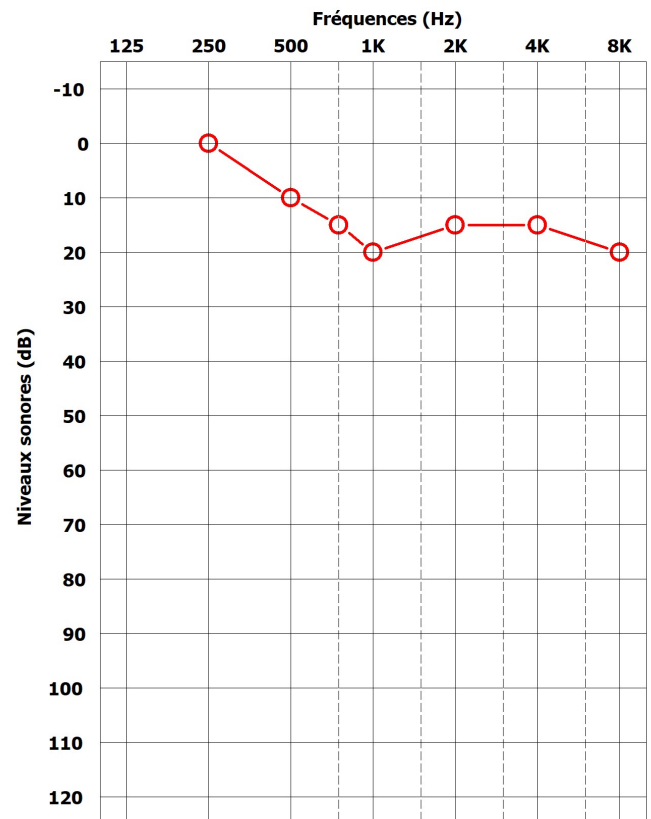

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	15	15		15		25		15
CA Droit		0	10	15	20		15		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes