

MEDVIE

Date du test: 19/03/2025 12:08:33

Durée: 6mn 15s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CAMARA SALIF

Date de naissance 24/04/1994

Age 30

Société AFRICA TRANSPORT


ID 25031912023453993

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

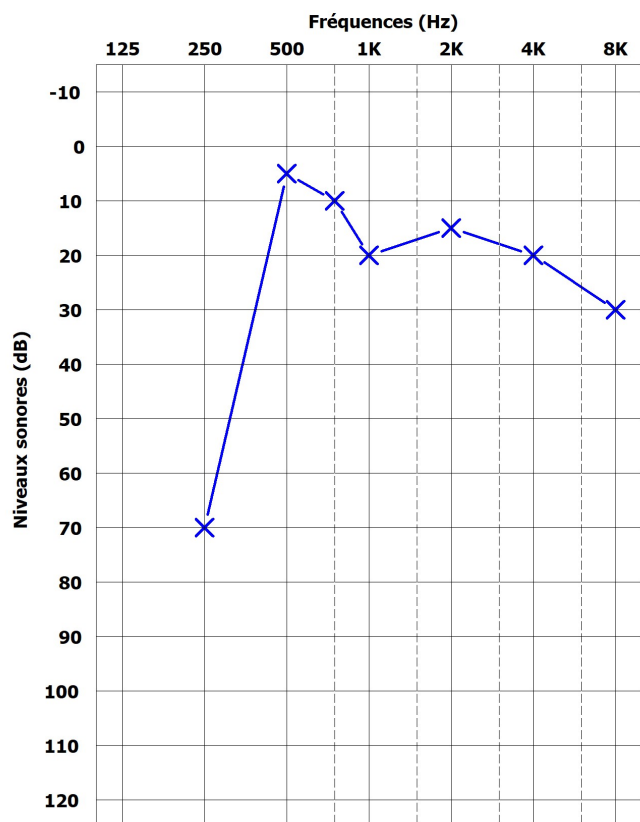

Oreille Gauche

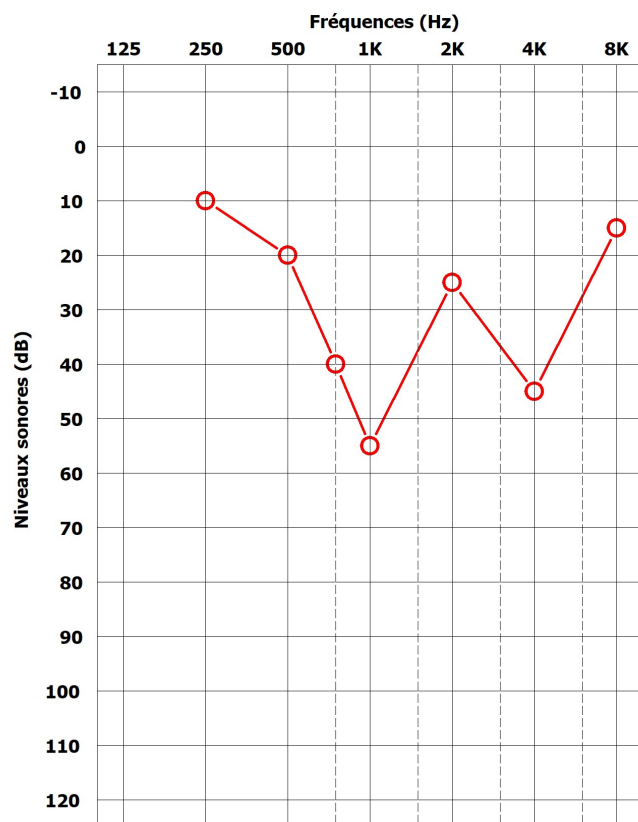

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		70	5	10	20		15		20		30
CA Droit		10	20	40	55		25		45		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	36,3 dB	---

Notes