


MEDVIE


Date du test: 01/04/2025 10:43:31
Durée: 6mn 38s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ISSIAKA	
Date de naissance	11/07/1974
Age	50
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25040110400175211

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

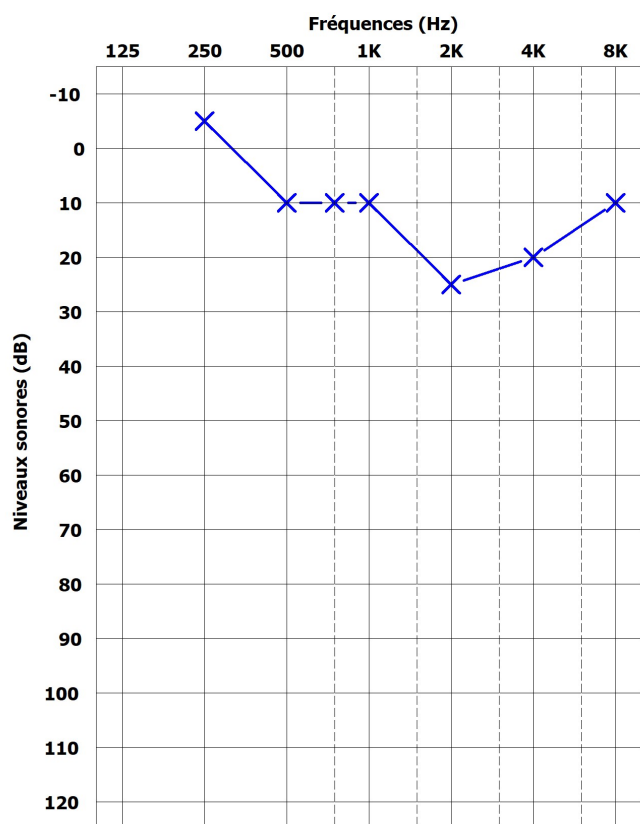

Oreille Gauche

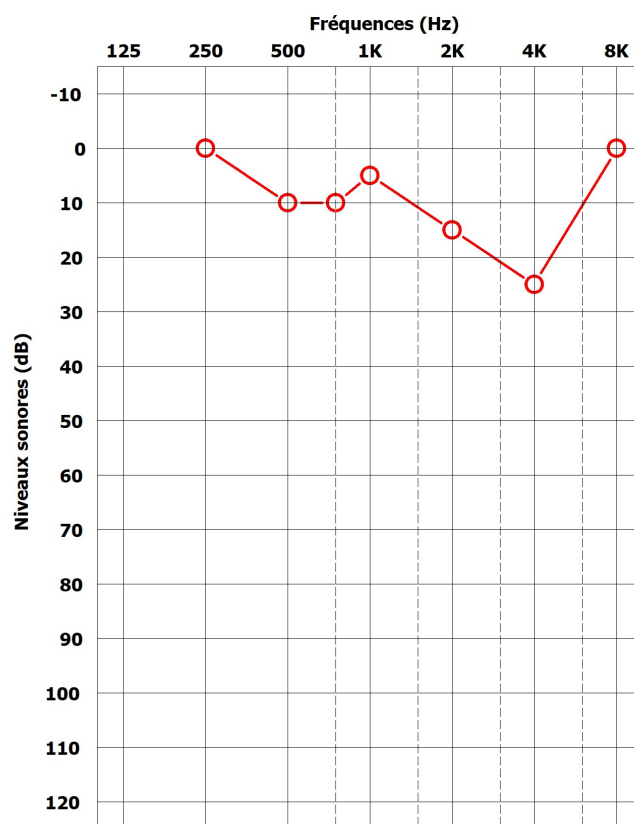

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	10	10	10		25		20		10
CA Droit		0	10	10	5		15		25		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes