


MEDVIE


Date du test: 25/03/2025 11:55:17
Durée: 5mn 00s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA KARIFA	
Date de naissance	05/02/1981
Age	44
Société	AFRICA TRANSPORT
ID	25032511522583661

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

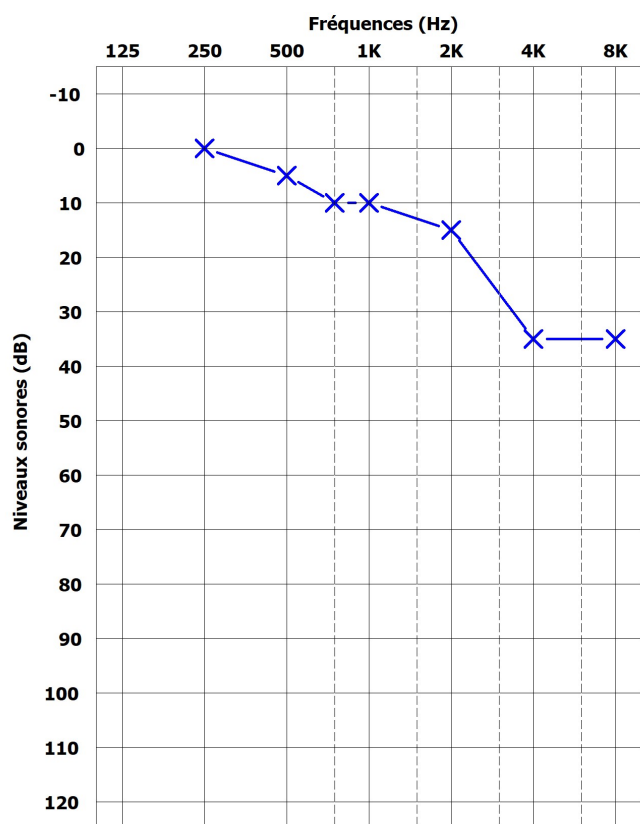

Oreille Gauche

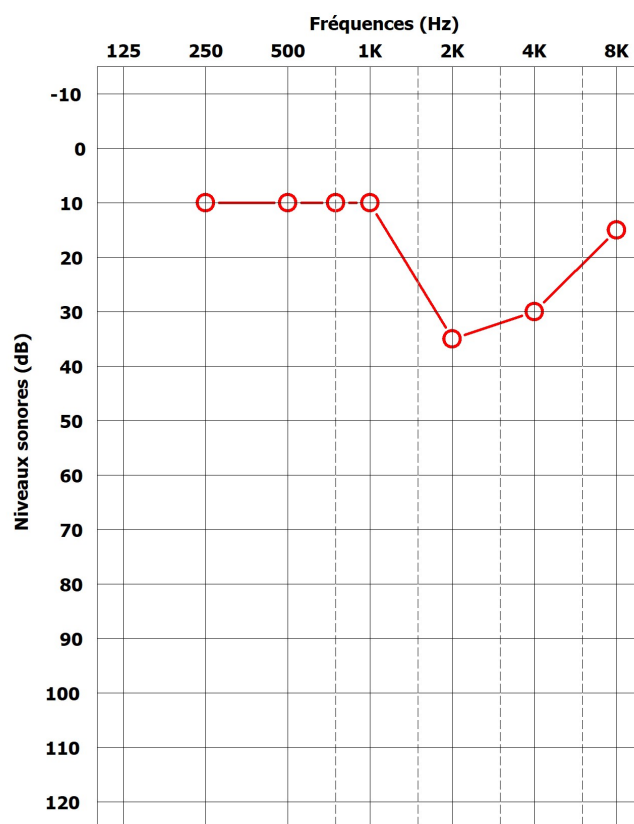

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	10	10		15		35		35
CA Droit		10	10	10	10		35		30		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes