


MEDVIE


Date du test: 31/01/2025 15:26:11
Durée: 5mn 34s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIENG MAMADOU
Date de naissance	01/01/1968	
Age	57	
Société	LYNX AFRICA GUINEE	
ID	25013115223112940	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

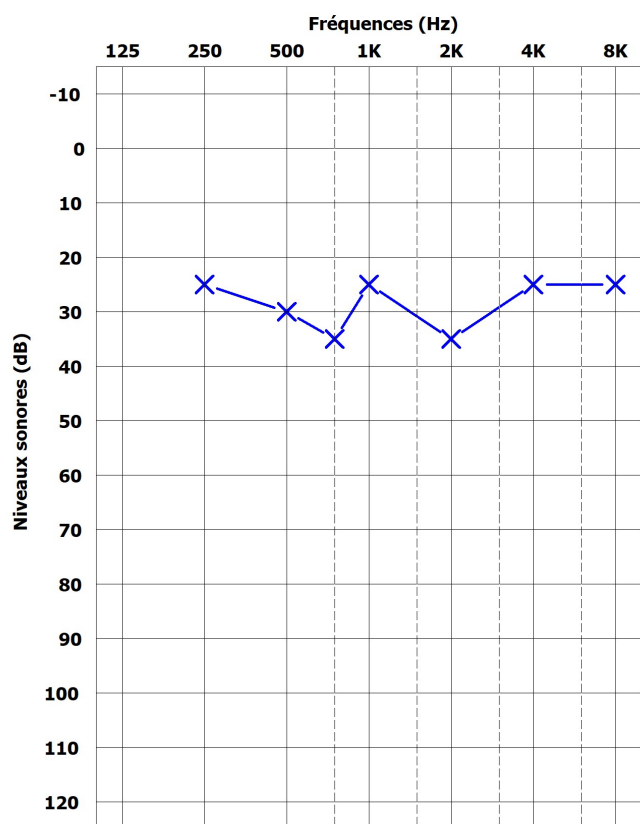

Oreille Gauche

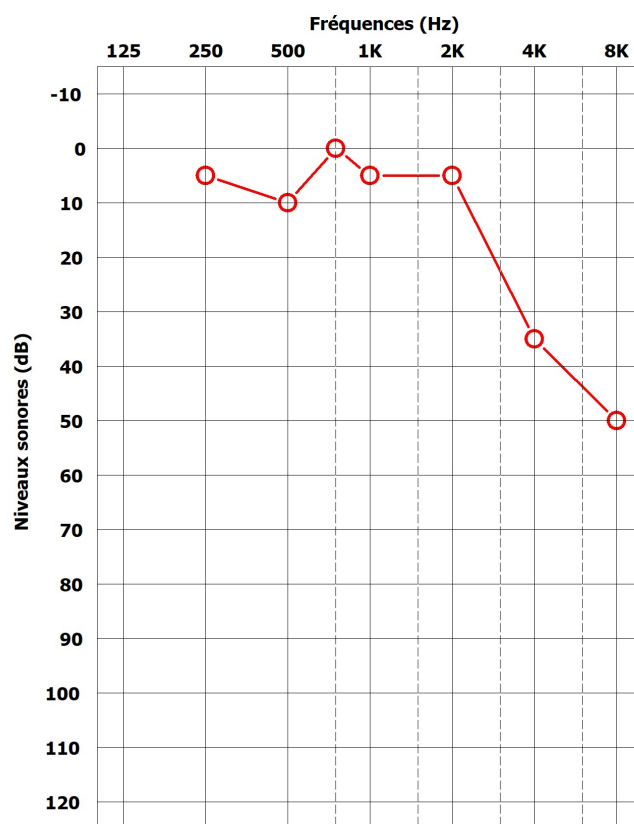

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	35	25		35		25		25
CA Droit		5	10	0	5		5		35		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes