

MEDVIE

Date du test: 31/01/2025 15:16:03
Durée: 5mn 36s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

TOURE NOUHAN


Date de naissance: 08/09/2001
Age: 23
Société: LYNX AFRICA GUINEE
ID: 25013115125570915

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

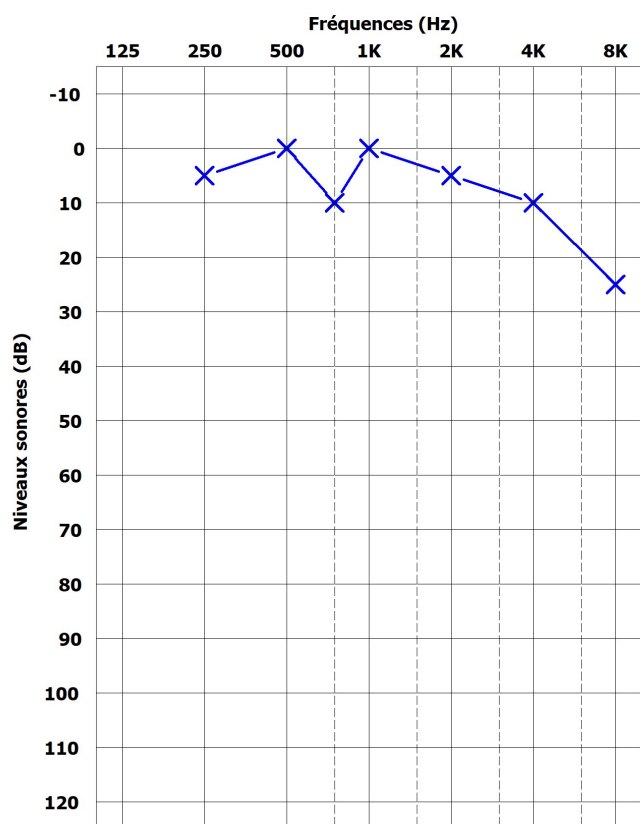

Oreille Gauche

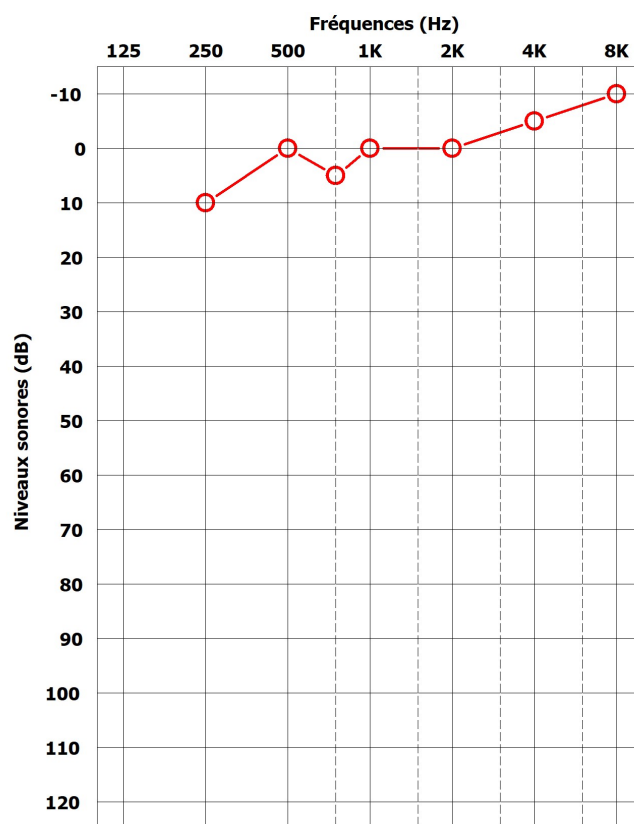

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	0	10	0		5		10		25
CA Droit		10	0	5	0		0		-5		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes