


Données Patient		SOW THERNO AMADOU
Date de naissance	04/04/1983	
Age	41	
Société	ITB LOGISTIQUE	
ID	25021912562936705	


MEDVIE

Date du test: 19/02/2025 12:58:35
 Durée: 7mn 58s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

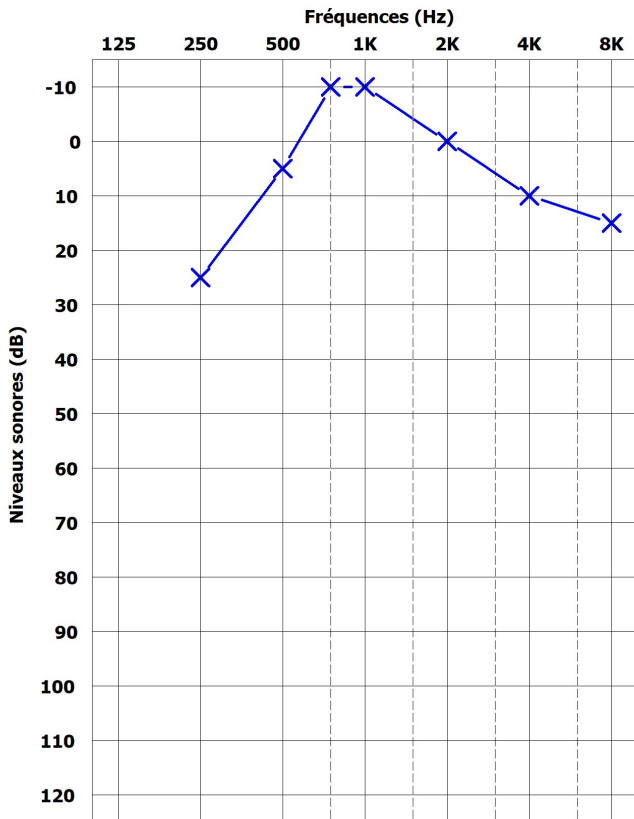

Oreille Gauche

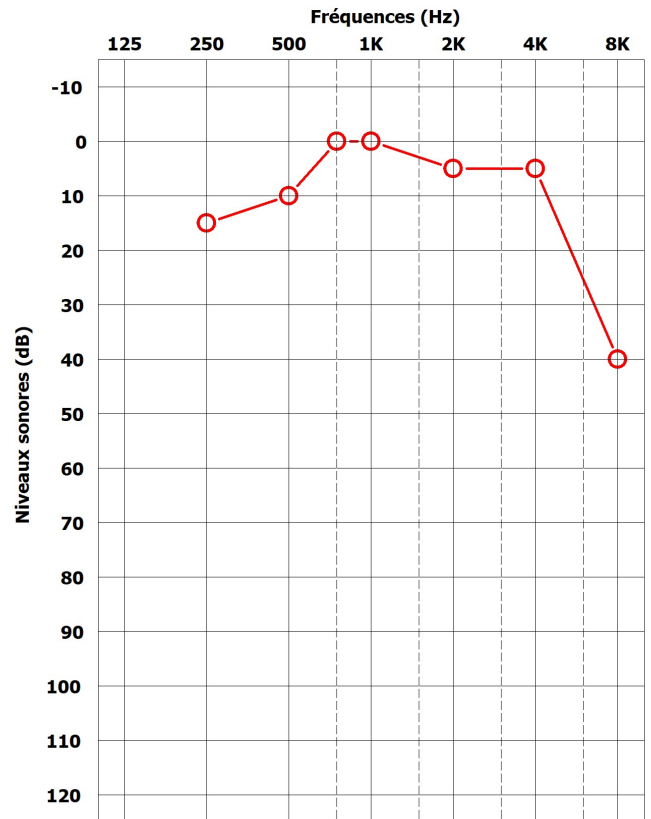

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	5	-10	-10		0		10		15
CA Droit		15	10	0	0		5		5		40

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	1,3 dB
CA Droit	5,0 dB	---

Notes