




MEDVIE


Date du test: 19/02/2025 12:48:46
Durée: 5mn 58s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO MAMADOU BAILO	
Date de naissance	02/01/1992
Age	33
Société	ITB LOGISTIQUE
ID	25021912464407030

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

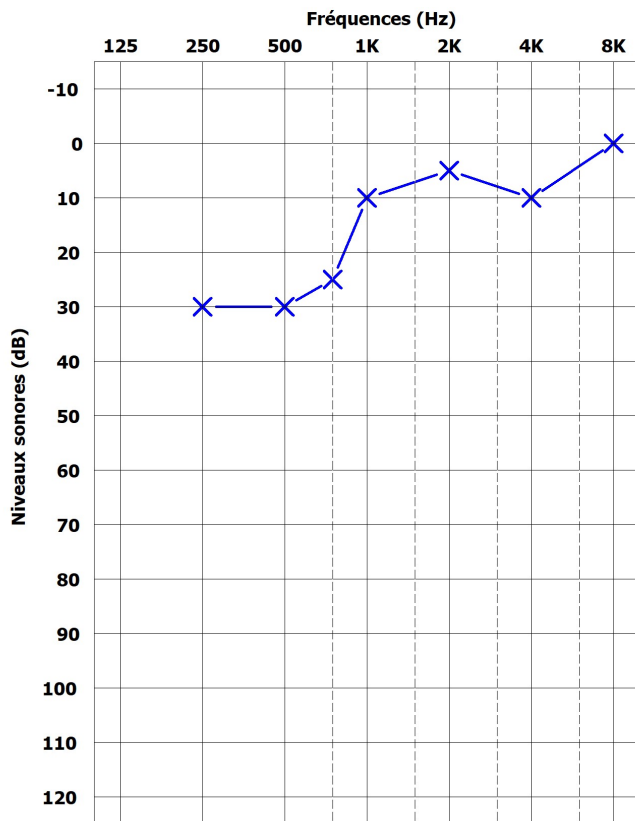

Oreille Gauche

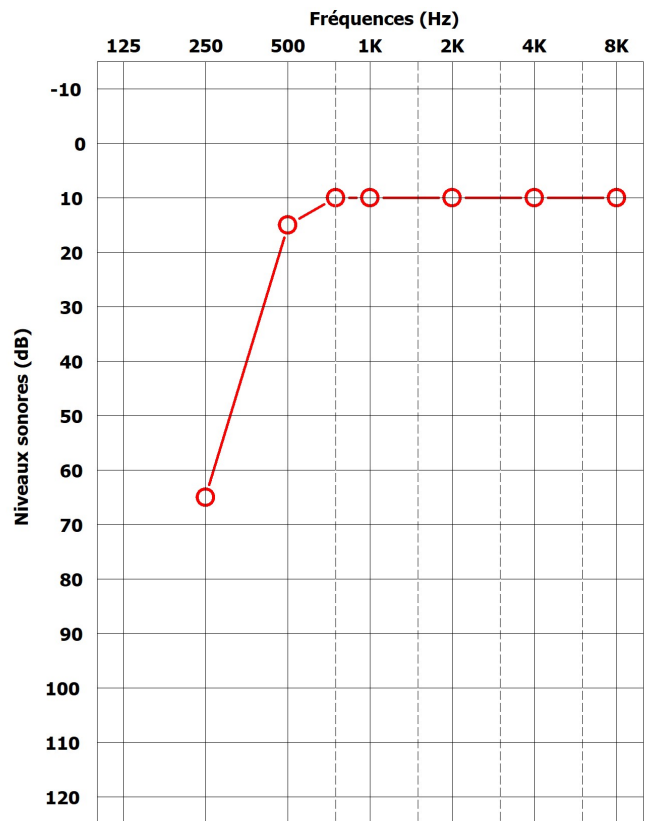

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	10		5		10		0
CA Droit		65	15	10	10		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes