


MEDVIE


Date du test: 19/02/2025 12:30:35
Durée: 6mn 57s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO ALPHA OUMAR	
Date de naissance	01/01/1963
Age	62
Société	ITB LOGISTIQUE
ID	25021912281694289

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

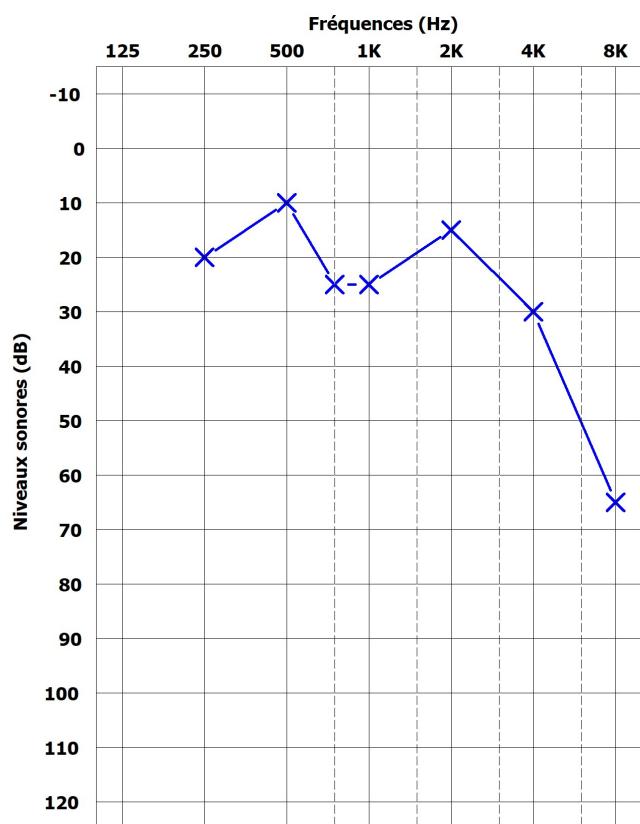

Oreille Gauche

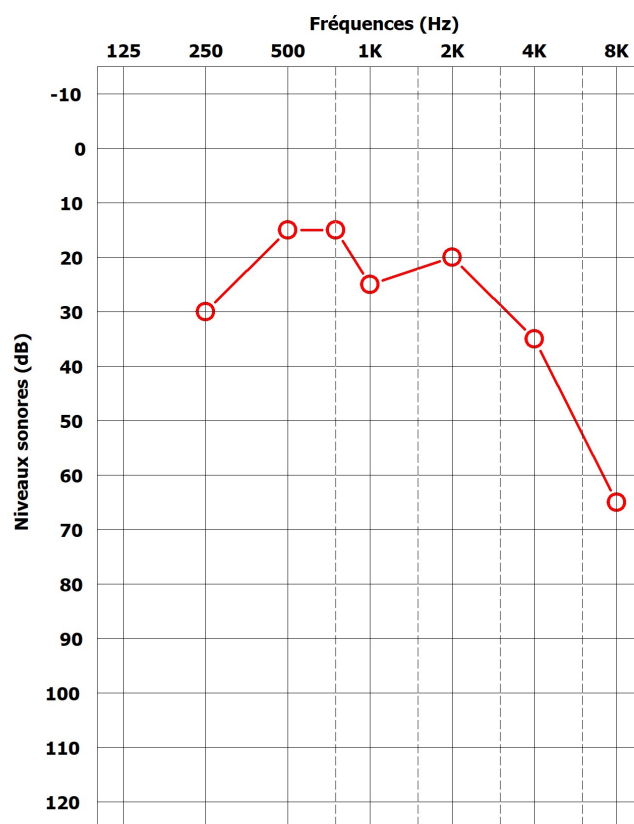

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	10	25	25		15		30		65
CA Droit		30	15	15	25		20		35		65

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes