

MEDVIE

Date du test: 29/03/2025 11:53:08

Durée: 3mn 59s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

GASSO MARCEL

Date de naissance 23/02/1995

Age 30

Société GENERAL WORK AFRICA


ID 25032911505289230

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

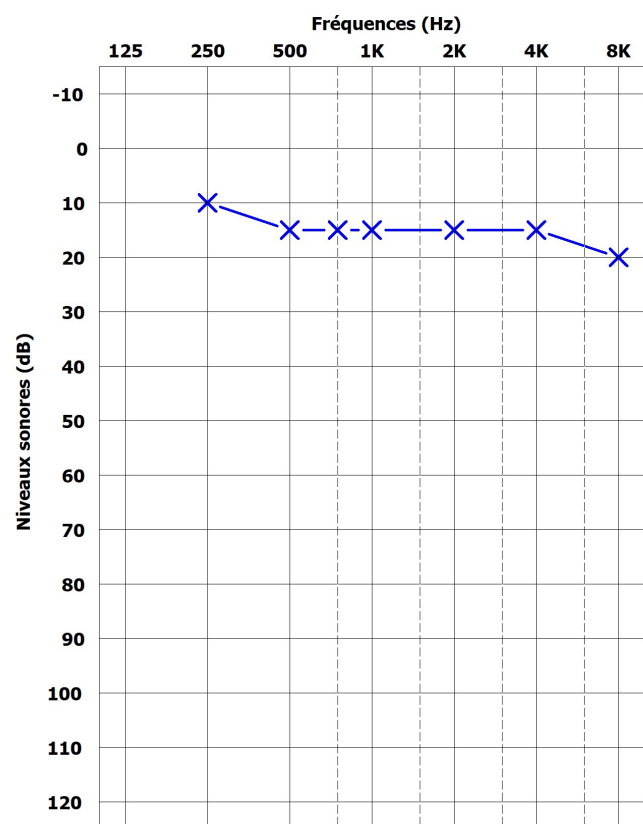

Oreille Gauche

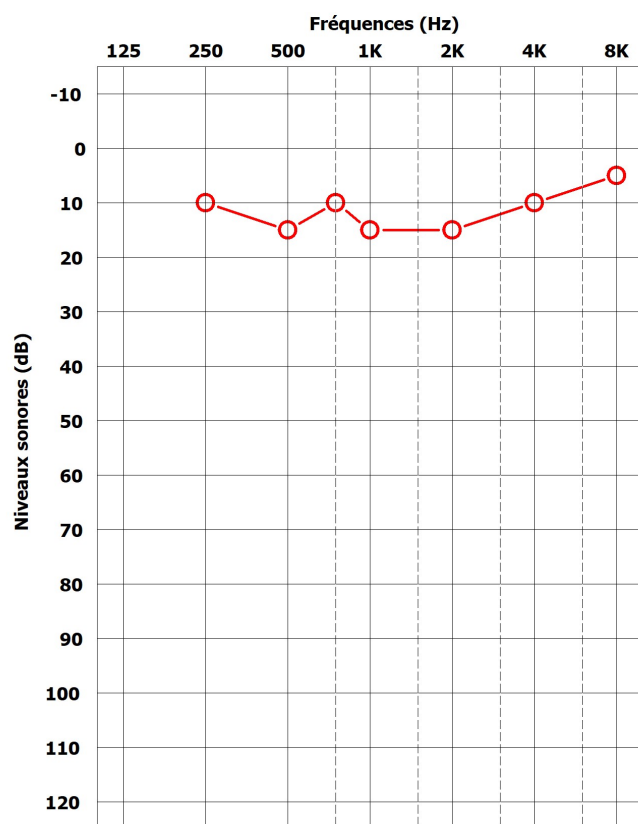

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	15		15		15		20
CA Droit		10	15	10	15		15		10		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes