


MEDVIE


Date du test: 29/03/2025 11:25:21

Durée: 6mn 24s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

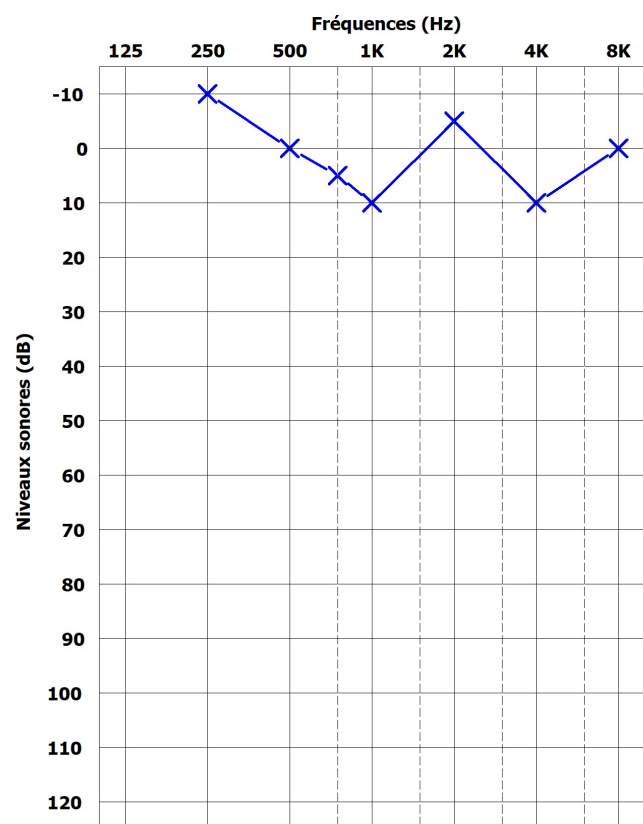

Oreille Gauche

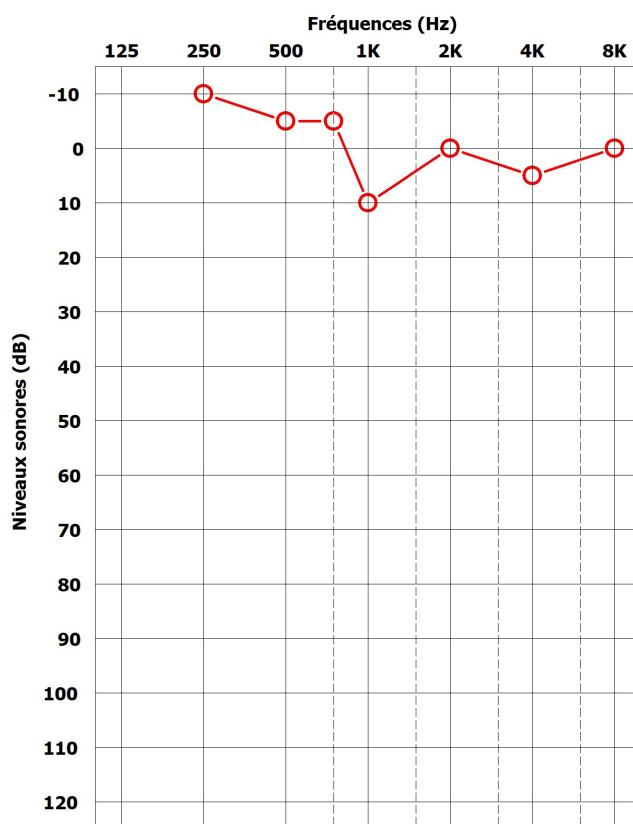

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | -10 | 0   | 5   | 10 |     | -5 |    | 10 |    | 0  |
| CA Droit  |     | -10 | -5  | -5  | 10 |     | 0  |    | 5  |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 3,8 dB | --- |
| CA Droit        | 2,5 dB | --- |

Notes

| Données Patient   | SOUAIBOU YAKOUBOU   |
|-------------------|---------------------|
| Date de naissance | 01/01/1990          |
| Age               | 35                  |
| Société           | GENERAL WORK AFRICA |
| ID                | 25032911223257242   |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |