


MEDVIE

Date du test: 29/03/2025 11:38:28

Durée: 6mn 28s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

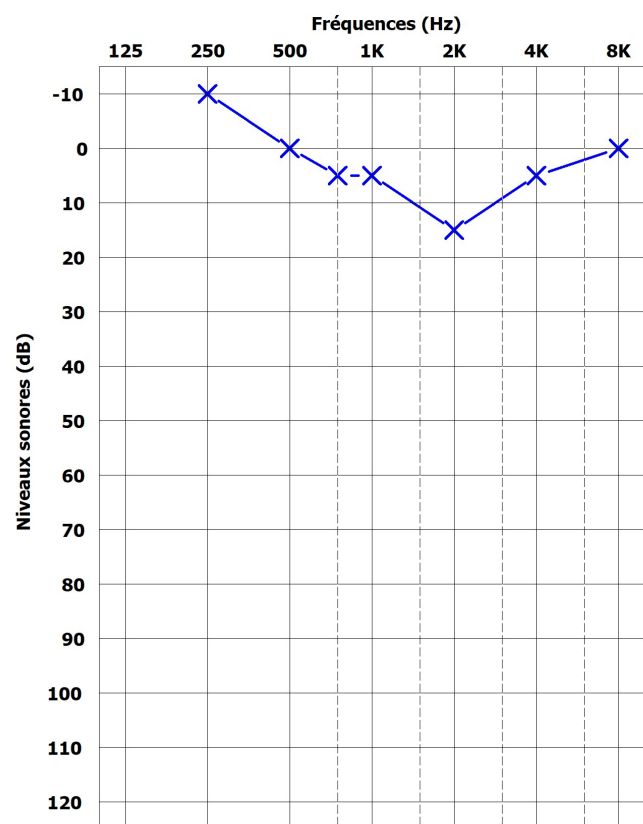

Oreille Gauche

| Données Patient   |                     | FOTSING MECADO<br>MARIIS |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Date de naissance | 07/07/1993          |                          |
| Age               | 31                  |                          |
| Société           | GENERAL WORK AFRICA |                          |
| ID                | 25032911351258098   |                          |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

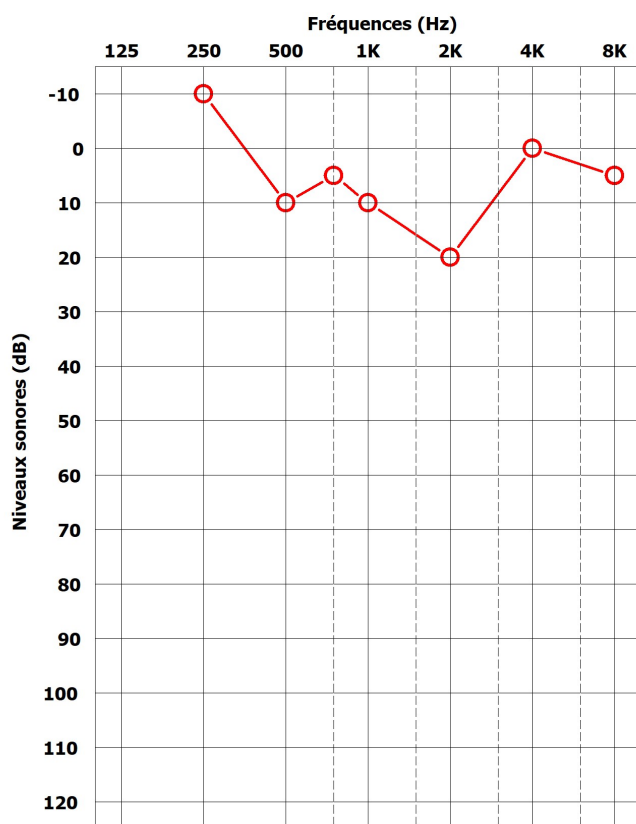

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | -10 | 0   | 5   | 5  |     | 15 |    | 5  |    | 0  |
| CA Droit  |     | -10 | 10  | 5   | 10 |     | 20 |    | 0  |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 6,3 dB  | --- |
| CA Droit        | 10,0 dB | --- |

Notes