

MEDVIE

Date du test: 12/03/2025 10:12:57

Durée: 4mn 21s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

TRAORE IBRAHIMA

Date de naissance 01/01/1988

Age 37

Société SONOLI


ID 25031210110390771

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

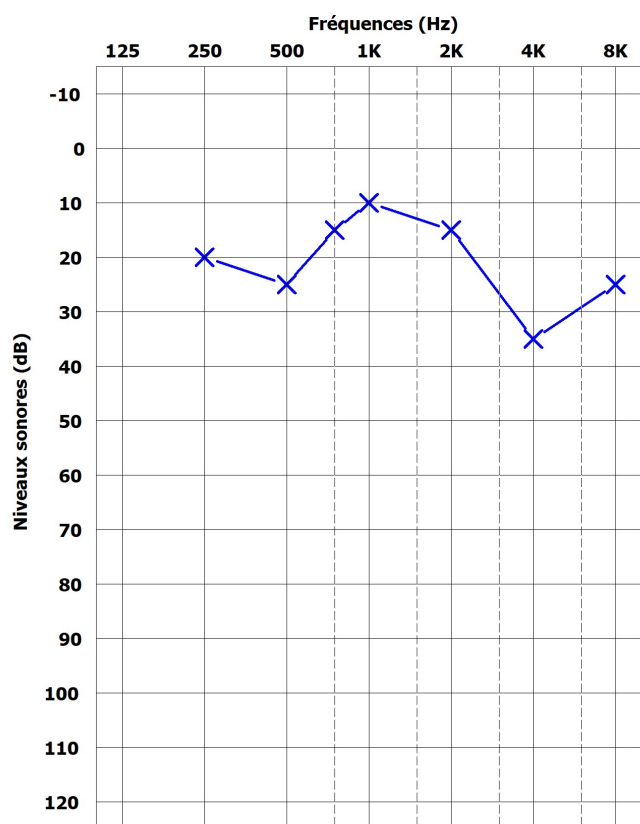

Oreille Gauche

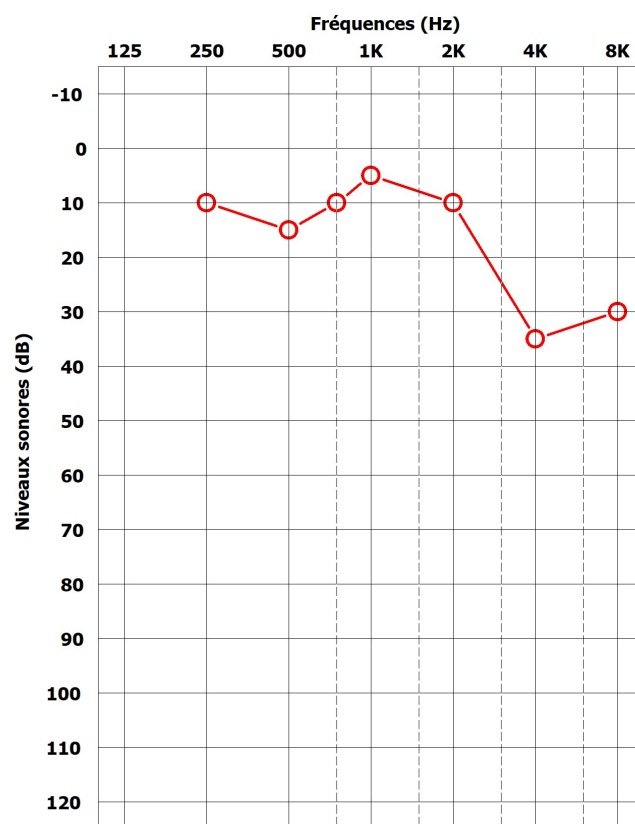

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	10		15		35		25
CA Droit		10	15	10	5		10		35		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes