

MEDVIE


Date du test: 22/08/2025 12:40:53

Durée: 6mn 04s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| CAMARA YAMOUSSA   |                   |
| Date de naissance | 01/01/1990        |
| Age               | 35                |
| Société           | GSL               |
| ID                | 25082212383199082 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

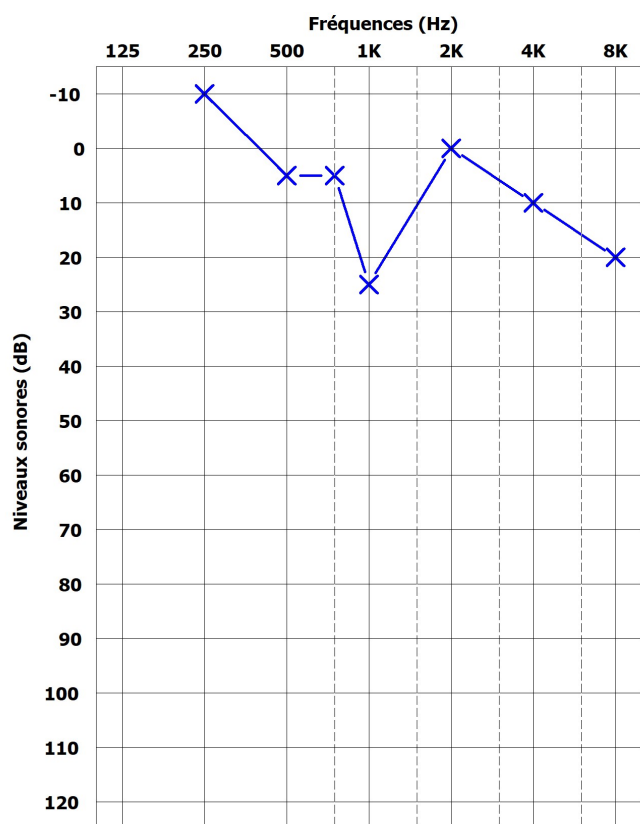

Oreille Gauche

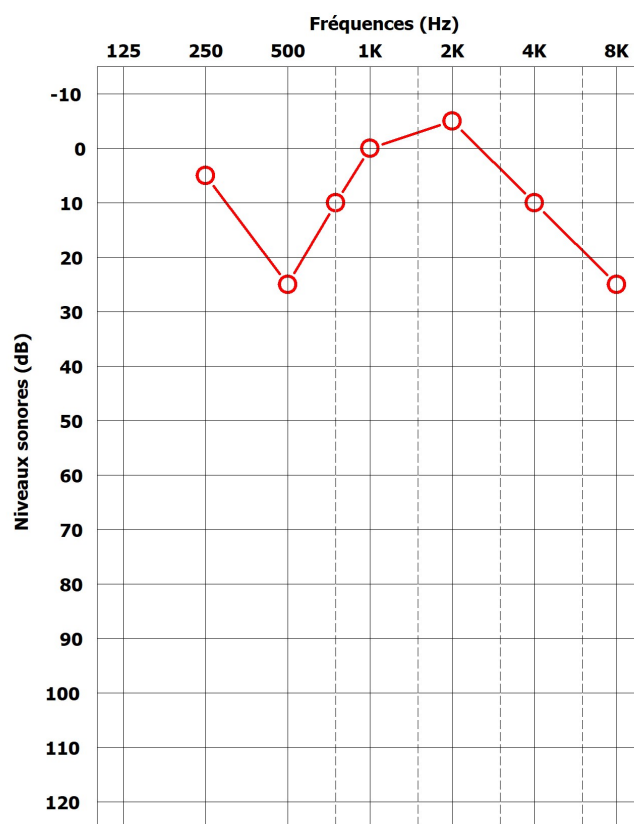

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | -10 | 5   | 5   | 25 |     | 0  |    | 10 |    | 20 |
| CA Droit  |     | 5   | 25  | 10  | 0  |     | -5 |    | 10 |    | 25 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 10,0 dB | --- |
| CA Droit        | 7,5 dB  | --- |

Notes