

MEDVIE


Date du test: 22/08/2025 09:52:42

Durée: 8mn 01s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO BOUBACAR	
Date de naissance	15/08/1997
Age	28
Société	GSL
ID	25082209495222009

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

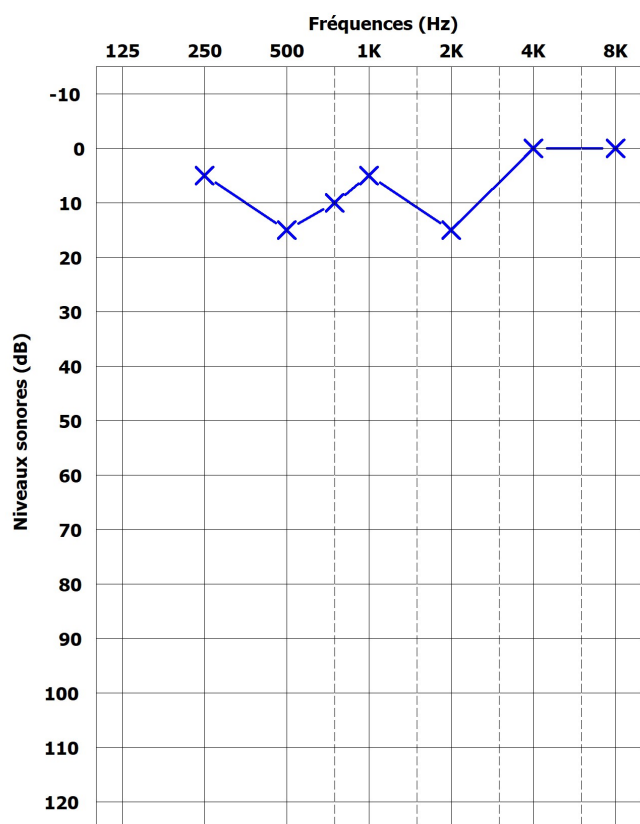

Oreille Gauche

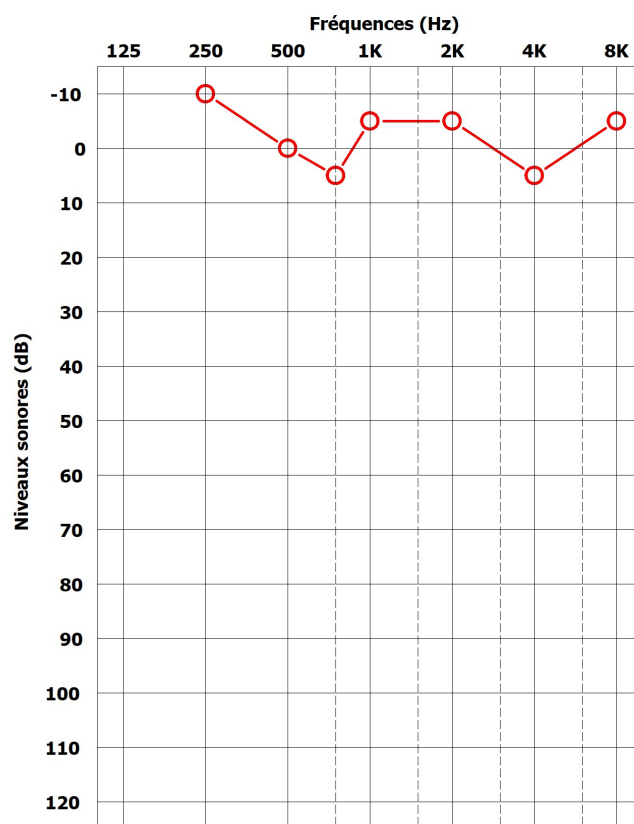

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	10	5		15		0		0
CA Droit		-10	0	5	-5		-5		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes