


MEDVIE


Date du test: 14/08/2025 11:38:37
Durée: 4mn 05s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BALDE MAADOU BACHIR	
Date de naissance	03/08/2001
Age	24
Société	GSL
ID	25081411323014621

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

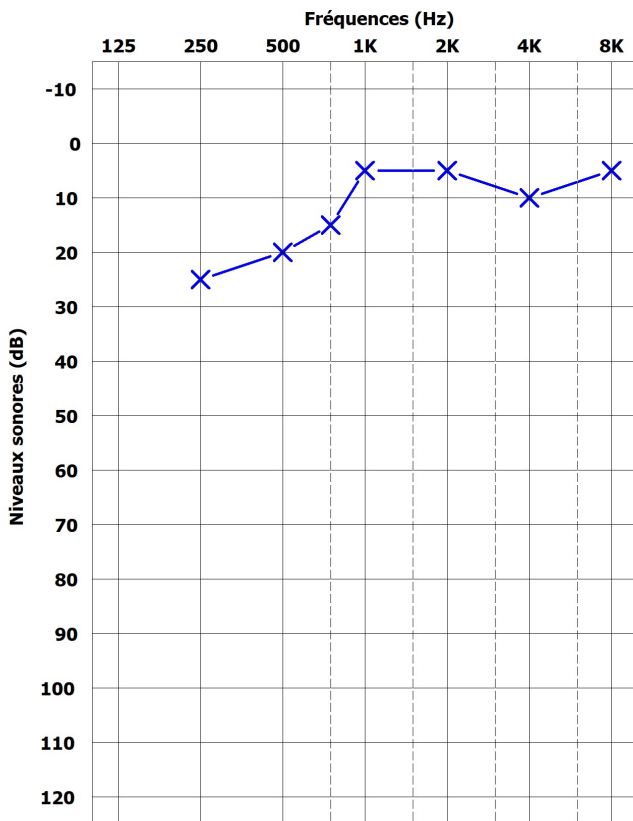

Oreille Gauche

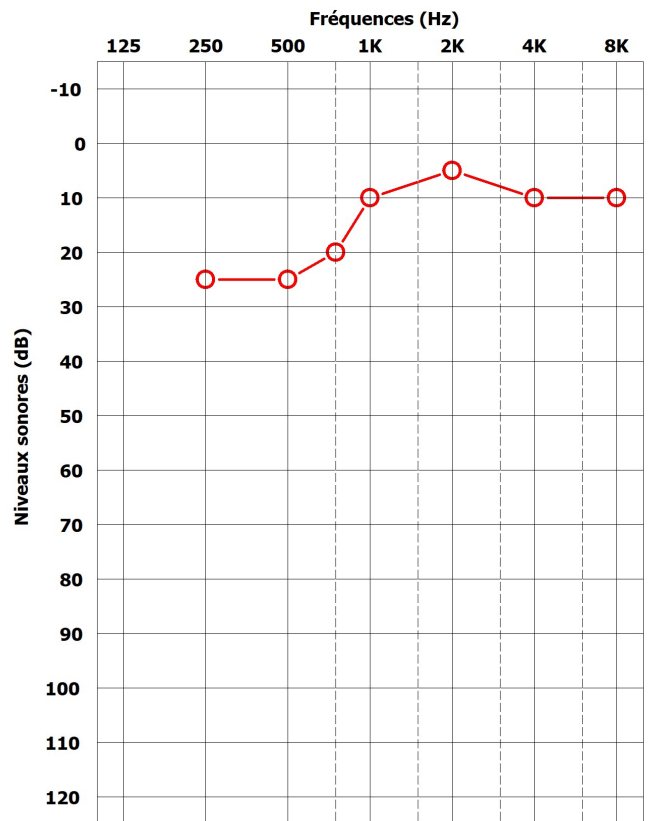

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	15	5		5		10		5
CA Droit		25	25	20	10		5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes