

MEDVIE


Date du test: 14/08/2025 11:57:21

Durée: 6mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BALDE ABDOULAYE
Date de naissance	15/07/2000
Age	25
Société	GSL
ID	25081411554068978

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

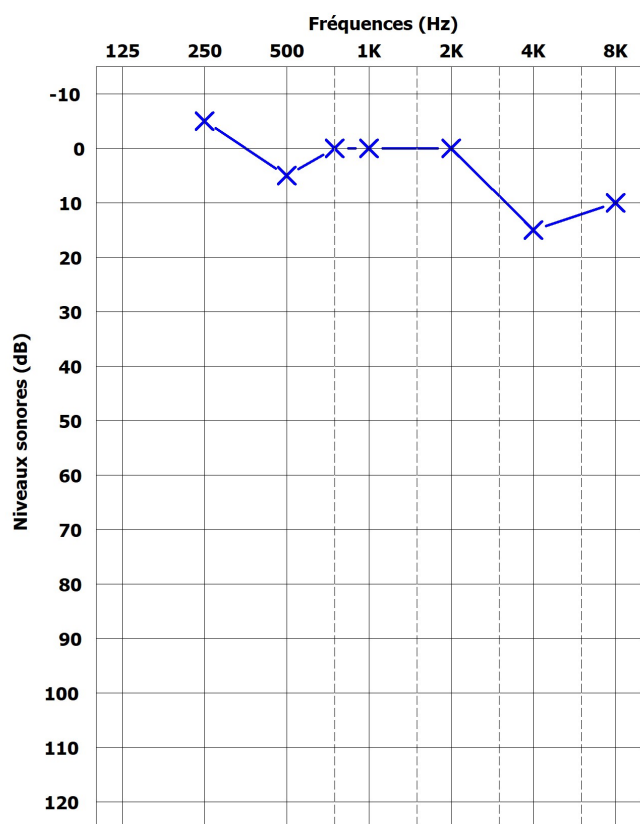

Oreille Gauche

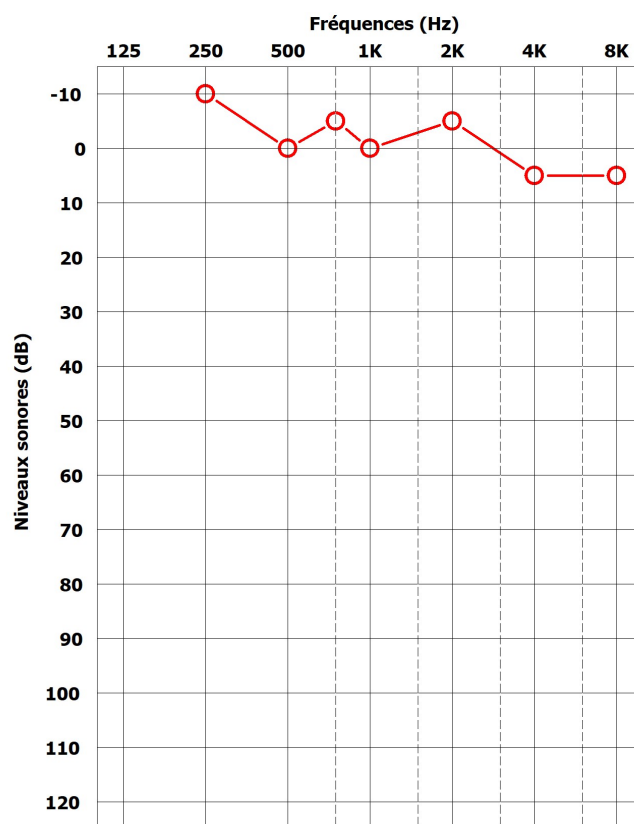

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	0	0		0		15		10
CA Droit		-10	0	-5	0		-5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes