


MEDVIE


Date du test: 19/08/2025 11:51:13

Durée: 8mn 24s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

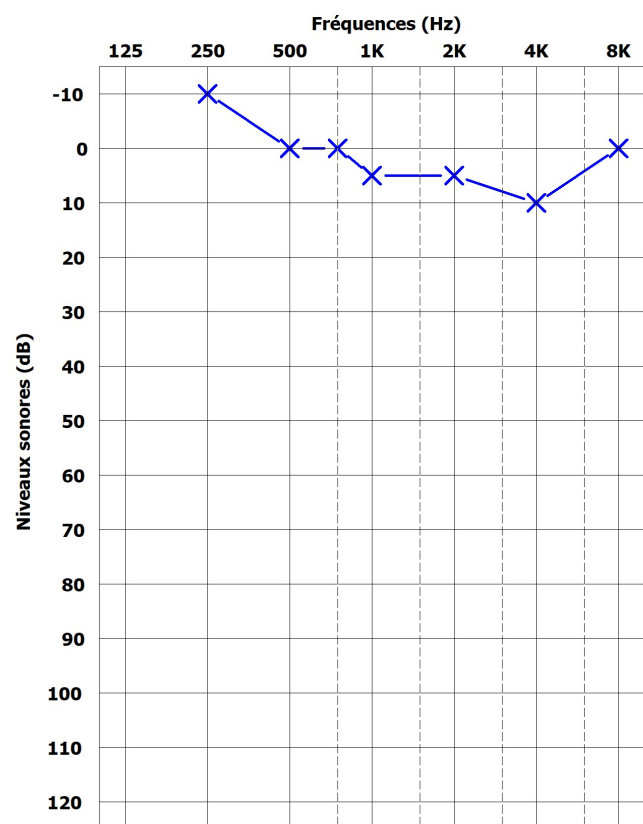

Oreille Gauche

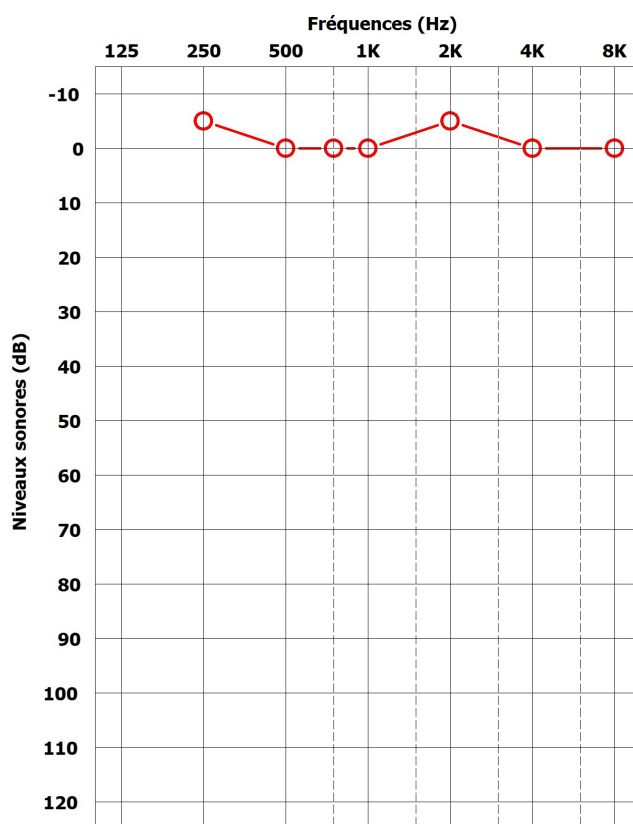

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	0	0	5		5		10		0
CA Droit		-5	0	0	0		-5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes

Données Patient	SOW AMADOU
Date de naissance	01/01/1988
Age	37
Société	GSL
ID	25081911390983807

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021