



MEDVIE

Date du test: 14/08/2025 11:25:08
Durée: 5mn 01s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

KEITA ISMAEL


Date de naissance: 01/01/1982
Age: 43
Société: GSL
ID: 25081411220960746

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

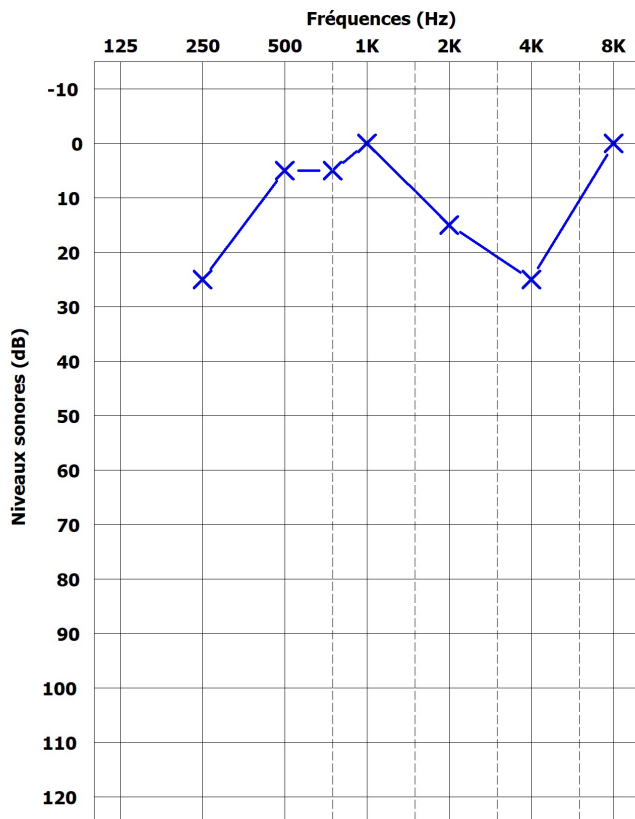

Oreille Gauche

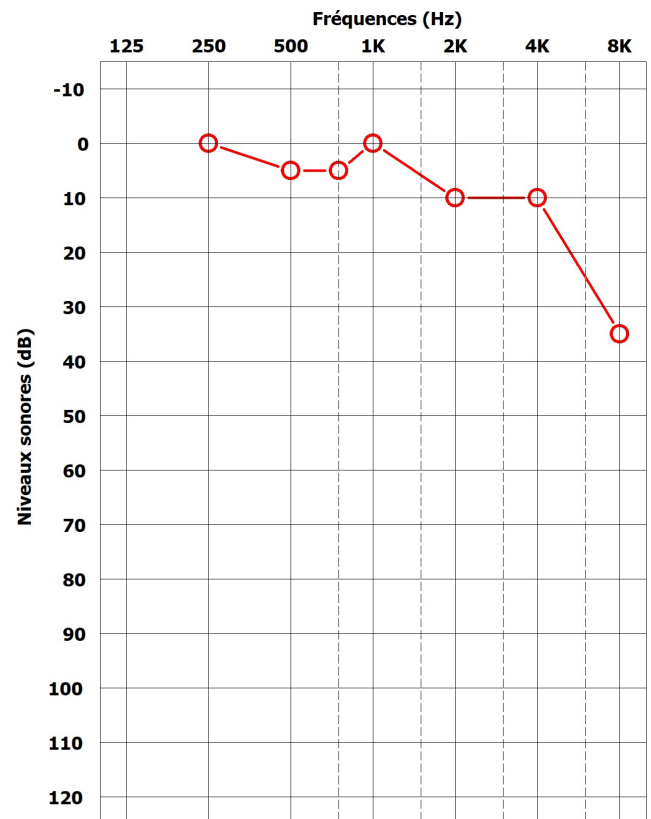

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	5	5	0		15		25		0
CA Droit		0	5	5	0		10		10		35

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes