


MEDVIE


Date du test: 14/04/2025 11:42:43

Durée: 5mn 03s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

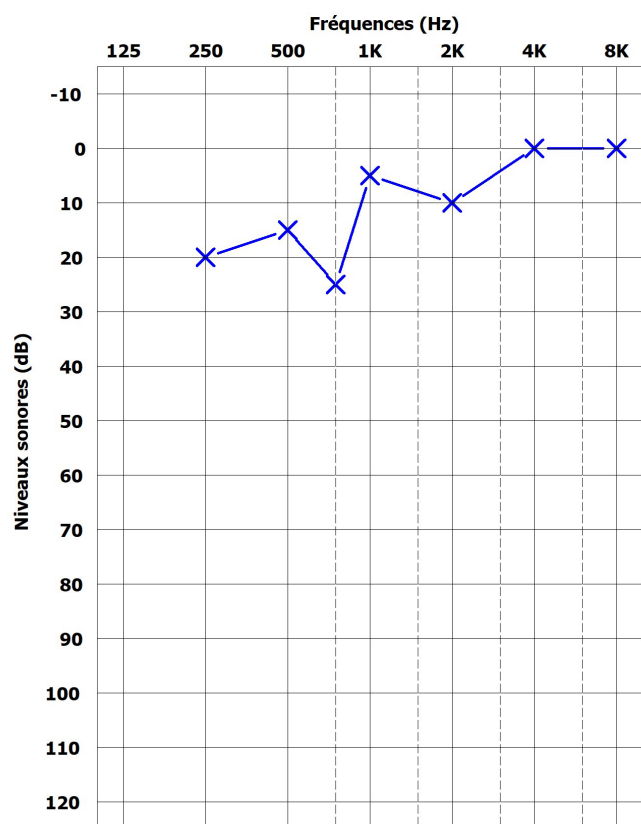

Oreille Gauche

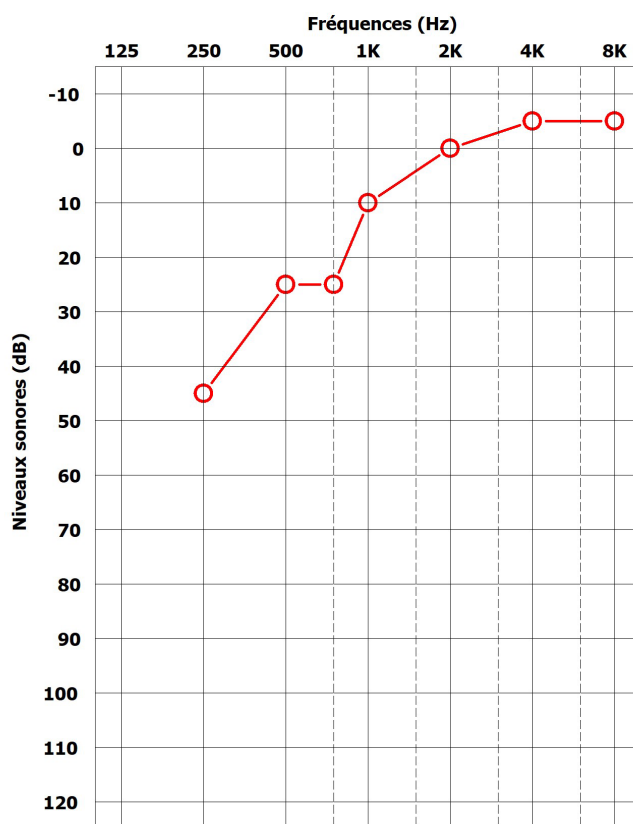

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	25	5		10		0		0
CA Droit		45	25	25	10		0		-5		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient	GLORIA NEKESA WERE
Date de naissance	21/06/1986
Age	38
Société	GLOBAL EDGE
ID	25041411395085098

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021